

1

Ръководство за употреба 2



All for Healthcare

1 2 3

2

Настройка на дата и час



3

1 2 3 4

4

5

1 2 3

START STOP

THIS WEEK 38/88 AVG AVG

288 SYS DIA

188

7:23

7:23

7:23

135 SYS DIA

82

73

SYS ≥ 135 mmHg
DIA ≥ 85 mmHg

SYS DIA



Ръководство за употреба 1, 3

Ръководство за употреба 1, 3


Ръководство за употреба 1, 3



Разглеждане на резултатите, запазени в паметта

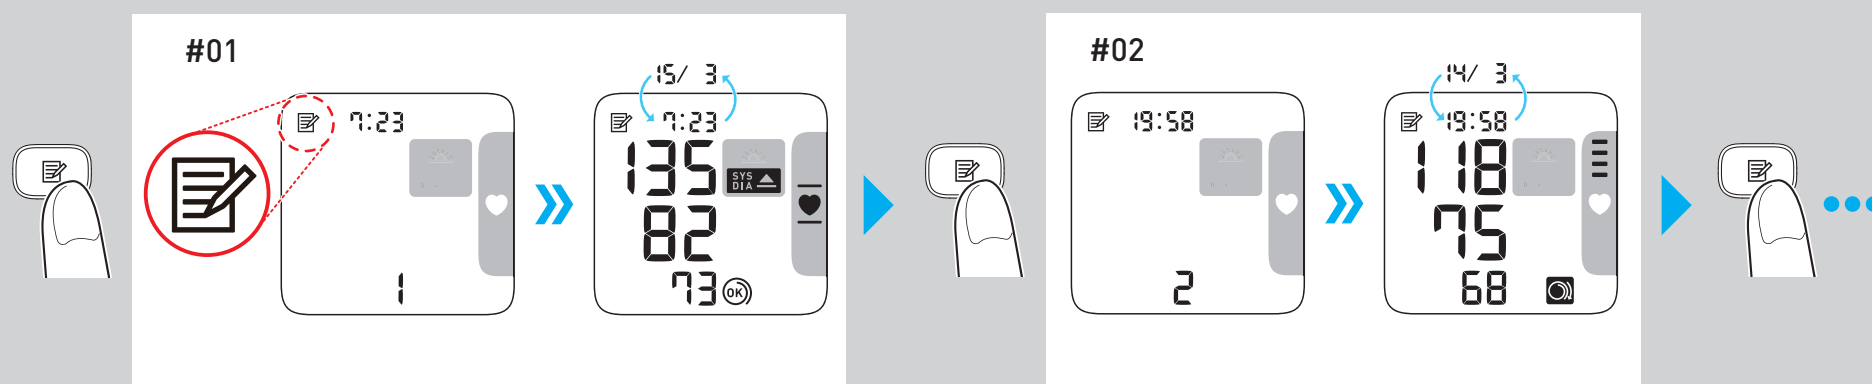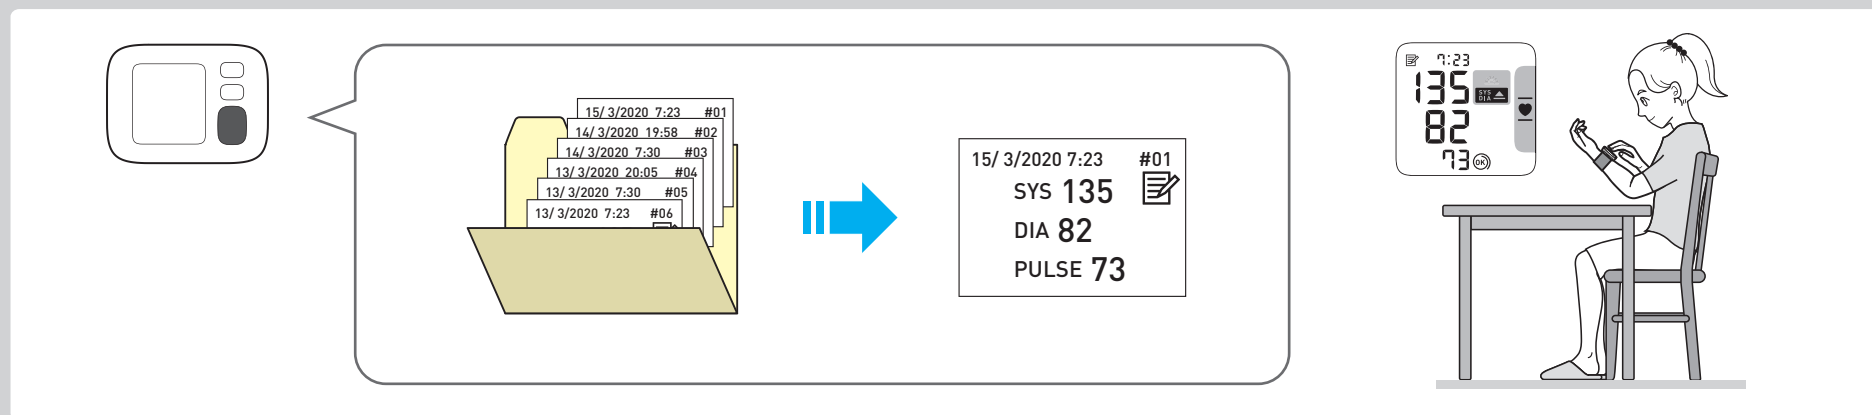

Изтриване на всички отчитания, запазени в паметта

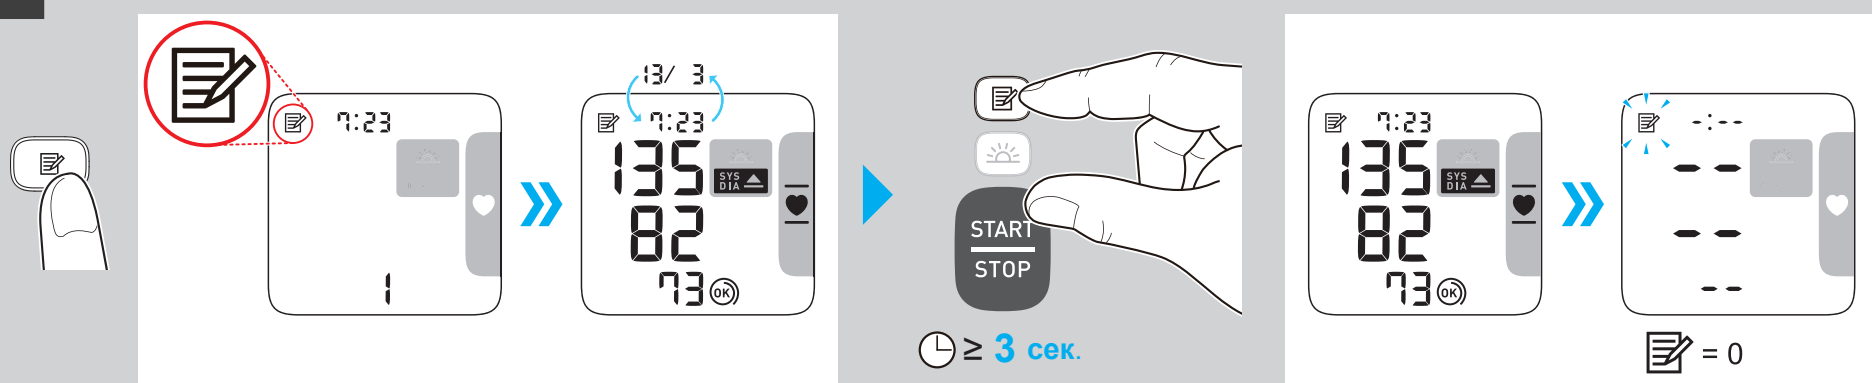

Описание на символите

	Приложна част – Тип ВF: Степен на защита срещу токов удар (ток на утечка)		Ограничение за температура
	Показва правилното позициониране на апарата върху китката. Подходяща обиколка на китката 13.5-21.5cm		Ограничение за влажност
IP XX	Степен на защита от проникване по IEC 60529		Ограничение за атмосферно налягане
CE	CE маркировка		Необходимост потребителят да направи справка с това ръководство за употреба.
UK CA	Маркировка UKCA		Необходимост потребителят да спазва старателно указанията в това ръководство за употреба с цел безопасност
SN	Сериен номер		Батерия
UDI	Уникален идентификатор на изделието		Постоянен ток
MD	Медицинско изделие		Дата на производство

Производител 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 ЯПОНИЯ
Представител за ЕС 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, ХОЛАНДИЯ www.omron-healthcare.com
Вносител в ЕС	
Производствена база	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Виетнам
Филиали	Вносител в Обединеното кралство и отговорно лице за Обединеното кралство OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Дата на издаване	2022-06-27