



1

Návod k obsluze 2



All for Healthcare

1 2 3

2

Nastavení data a času



3

1 2 3 4

4

5

1

2



3

Návod k obsluze 1 1.3


Návod k obsluze 1 1.3



## Prohlížení uložených naměřených hodnot

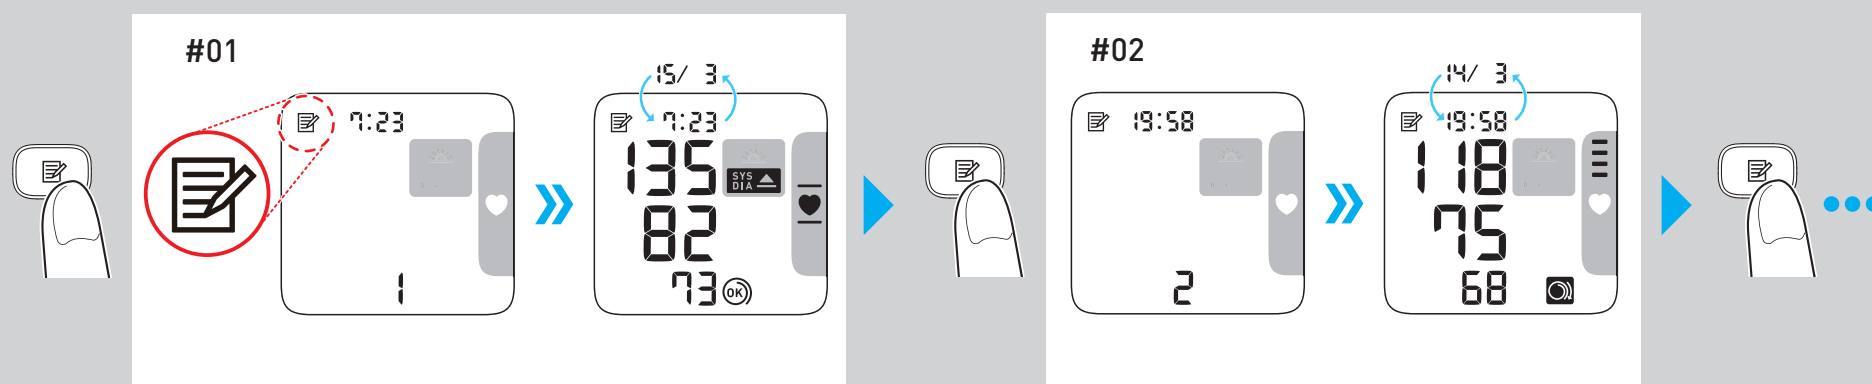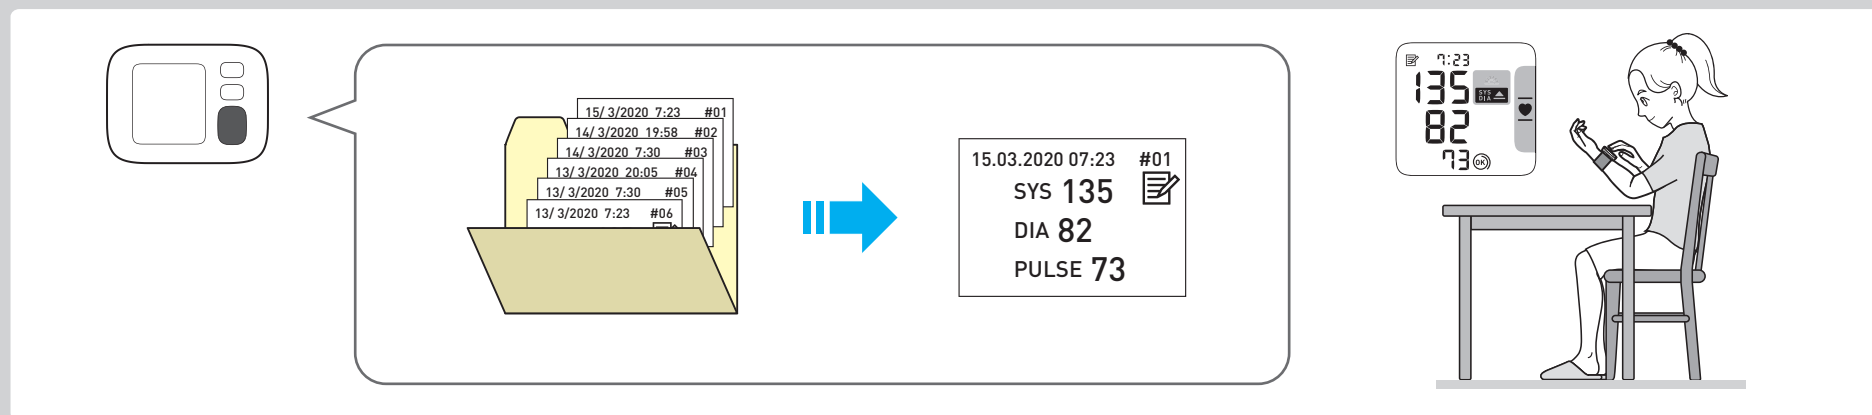

## Smazání všech naměřených hodnot uložených v paměti

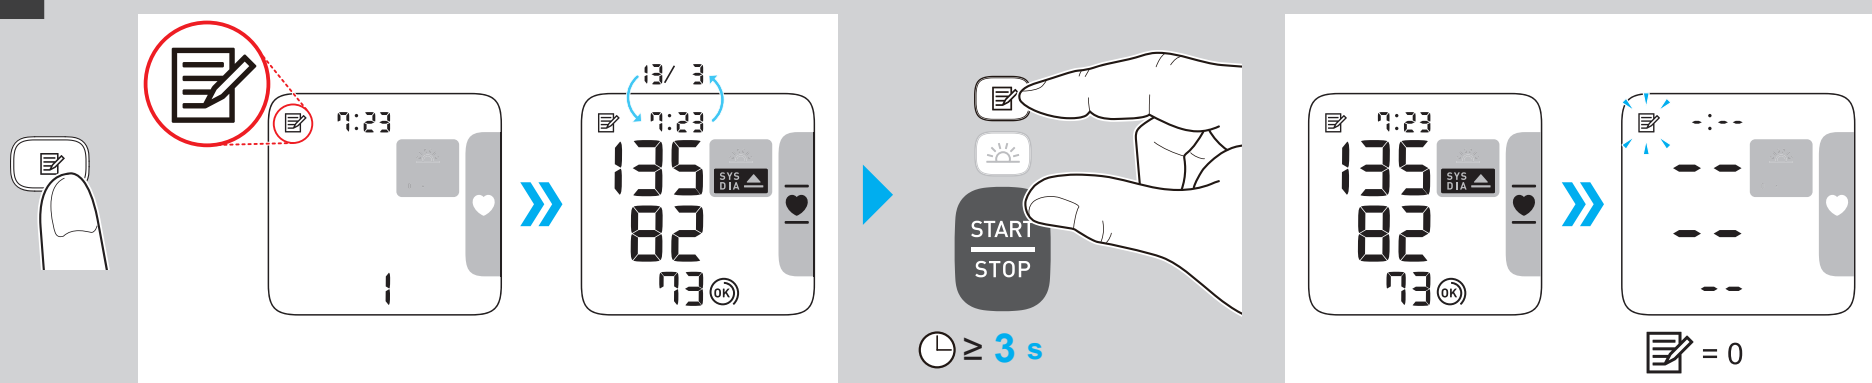

## Popis symbolů

	Příložná část – typ BF: Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem (svodový proud)		Omezení teploty
	Indikuje správnou polohu měřiče na zápěstí. Měřitelný obvod zápěstí 13,5-21,5cm		Omezení vlhkosti
IP XX	Stupeň ochrany proti vniknutí zajišťovaný normou IEC 60529		Omezení atmosférického tlaku
CE	Označení CE		Uživatel si musí prostudovat tento návod k obsluze.
UK CA	Certifikace UKCA		Uživatel musí pečlivě dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze kvůli zajištění bezpečnosti
SN	Sériové číslo		Baterie/článek
UDI	Jedinečná identifikace prostředku (UDI)		Stojnosměrný proud
MD	Zdravotnický prostředek		Datum výroby

<b>Výrobce</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
<b>Zástupce pro EU</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
<b>Dovozce do EU</b>	
<b>Výrobní závod</b>	<b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
<b>Pobočky</b>	<b>Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK</b> <b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> www.omron-healthcare.com/distributors
	<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> www.omron-healthcare.com/distributors
<b>Datum vydání</b>	2022-06-27