



1

Brugsanvisning 2



1 2 3

All for Healthcare

2

Indstilling af dato og klokkeslæt



3

1 2 3 4

4

5

1



2

3 **SYS ≥ 135 mmHg**  
**DIA ≥ 85 mmHg** → **SYS DIA**  
Brugsanvisning 1, 1,3


Brugsanvisning 1, 1,3



## Visning af målinger i hukommelsen

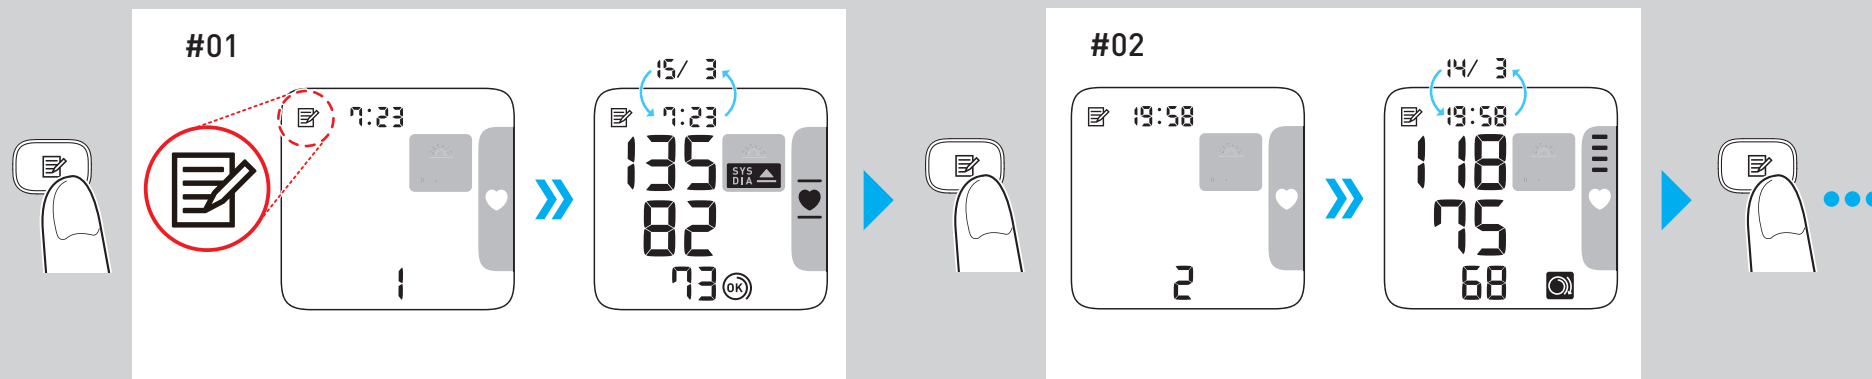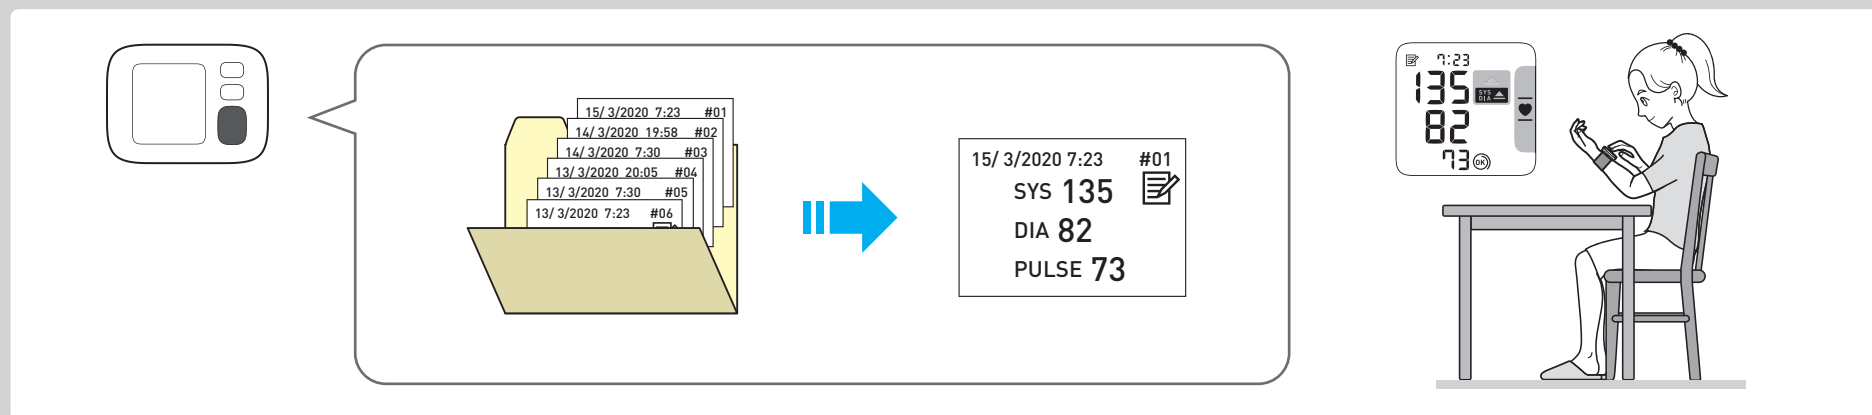

## Sletter alle målinger i hukommelsen

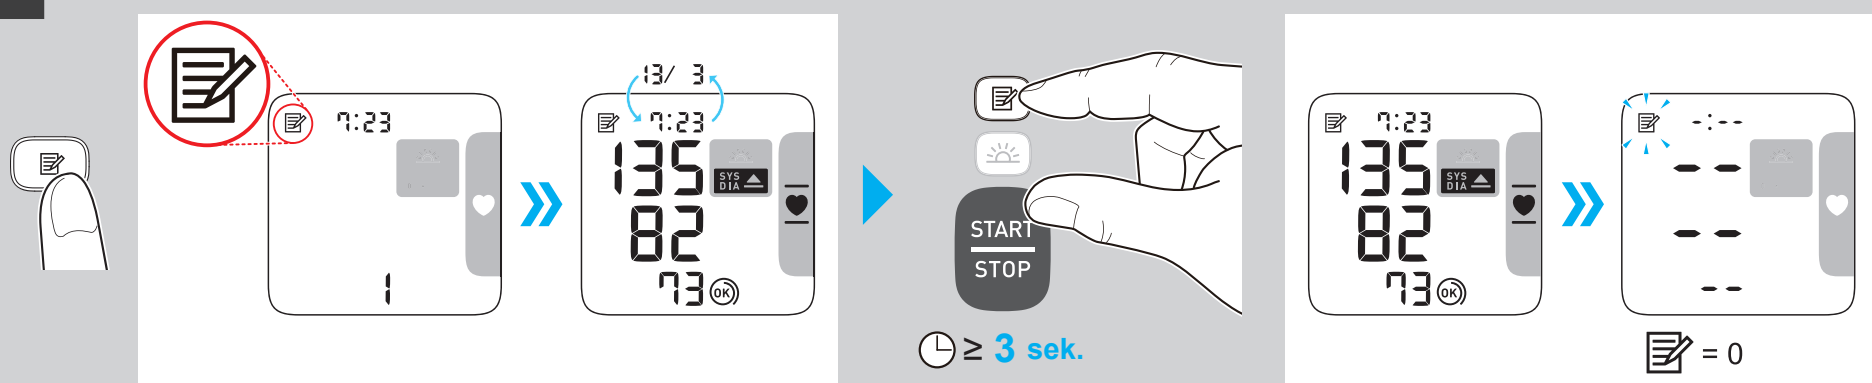

## Symbolbeskrivelse

	Patientdel - type BF: Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød (lækstrøm)		Temperaturbegrænsning
 13.5-21.5cm	Angiver apparatets korrekte placering på håndleddet. Målar håndledsomsreds		Fugtighedsbegrænsning
IP XX	Indrængningsbeskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529		Grænse for atmosfærisk tryk
CE	CE-mærkning		Læs brugervejledningen.
UK CA	UKCA-mærkning		Følg brugervejledningen omhyggeligt af hensyn til din sikkerhed
SN	Serie nr.		Batteri / søjle
UDI	Unik enhedsidentifikator		Jævnstrøm
MD	Medicinsk udstyr		Produktionsdato

<b>Producent</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
<b>EU-repræsentant</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>
<b>Importer i EU</b>	<b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
<b>Produktionsanlæg</b>	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>
<b>Datterselskaber</b>	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a> <b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>
<b>Udstedelsesdato</b>	2022-06-27