




1

Lietošanas instrukcija 2

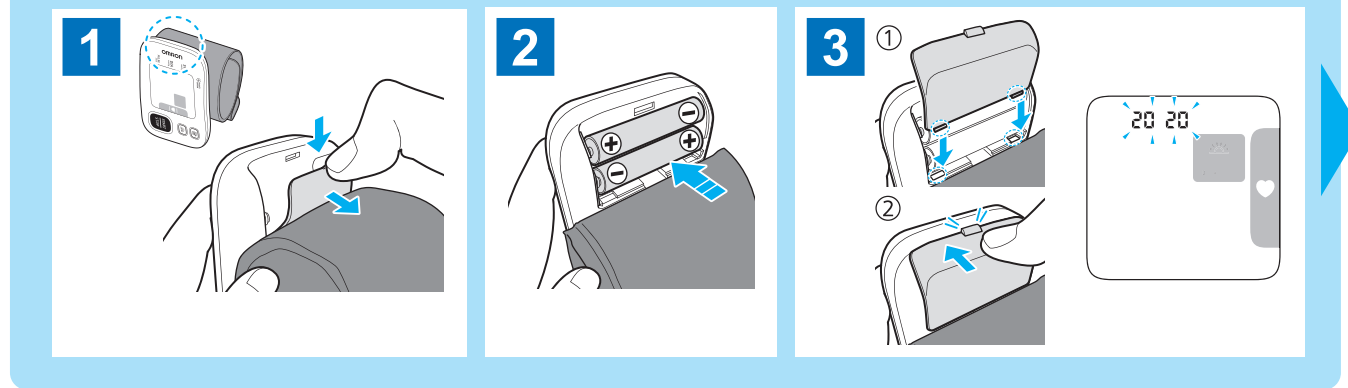


All for Healthcare

2


Datuma un laika iestatīšana






3

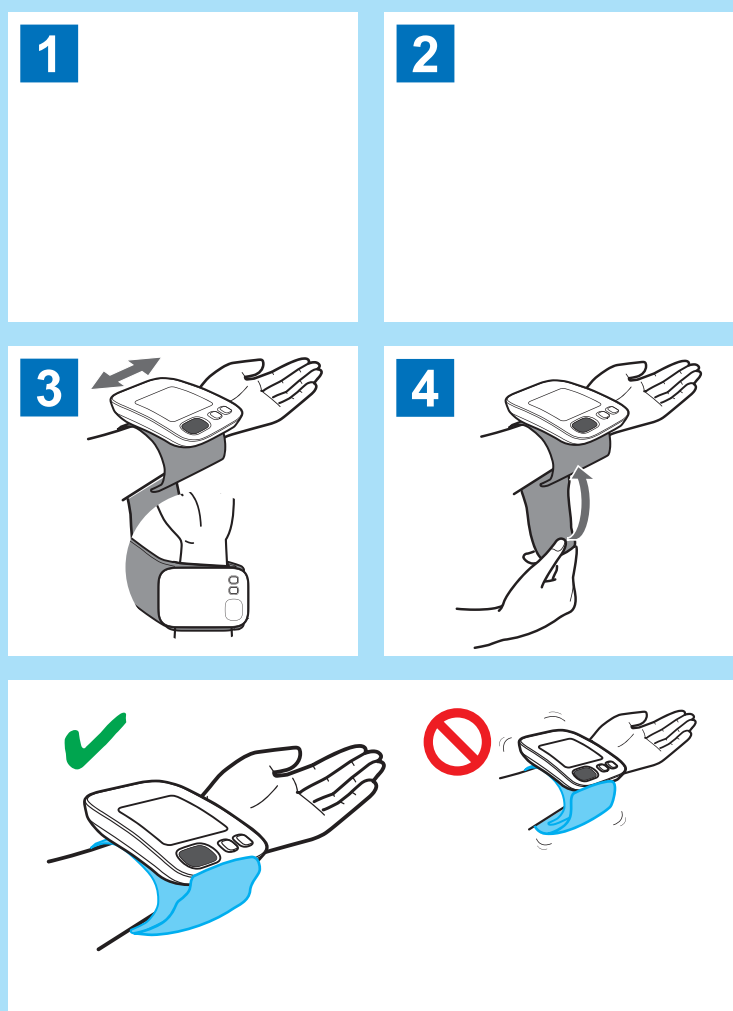

4


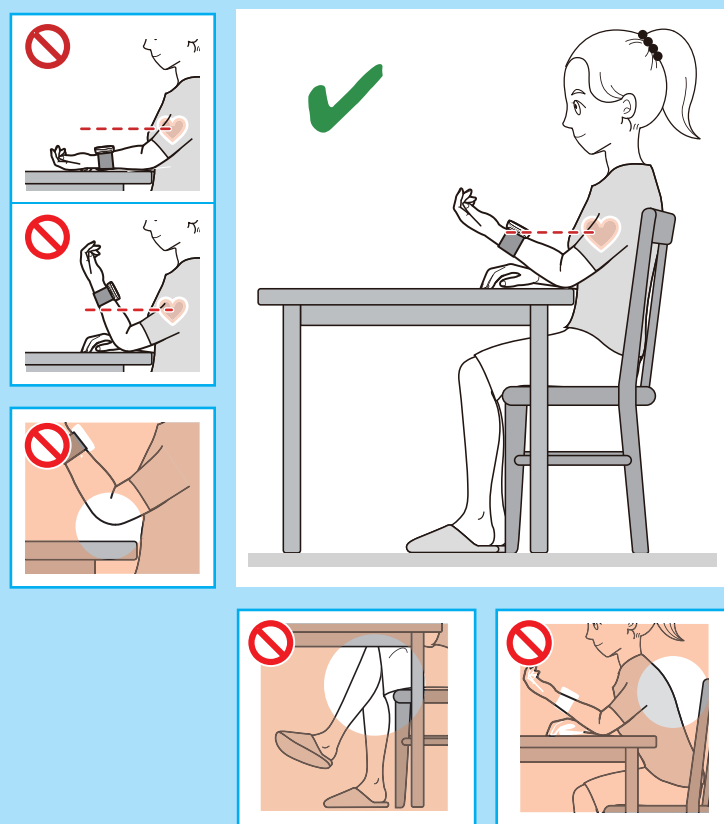


5

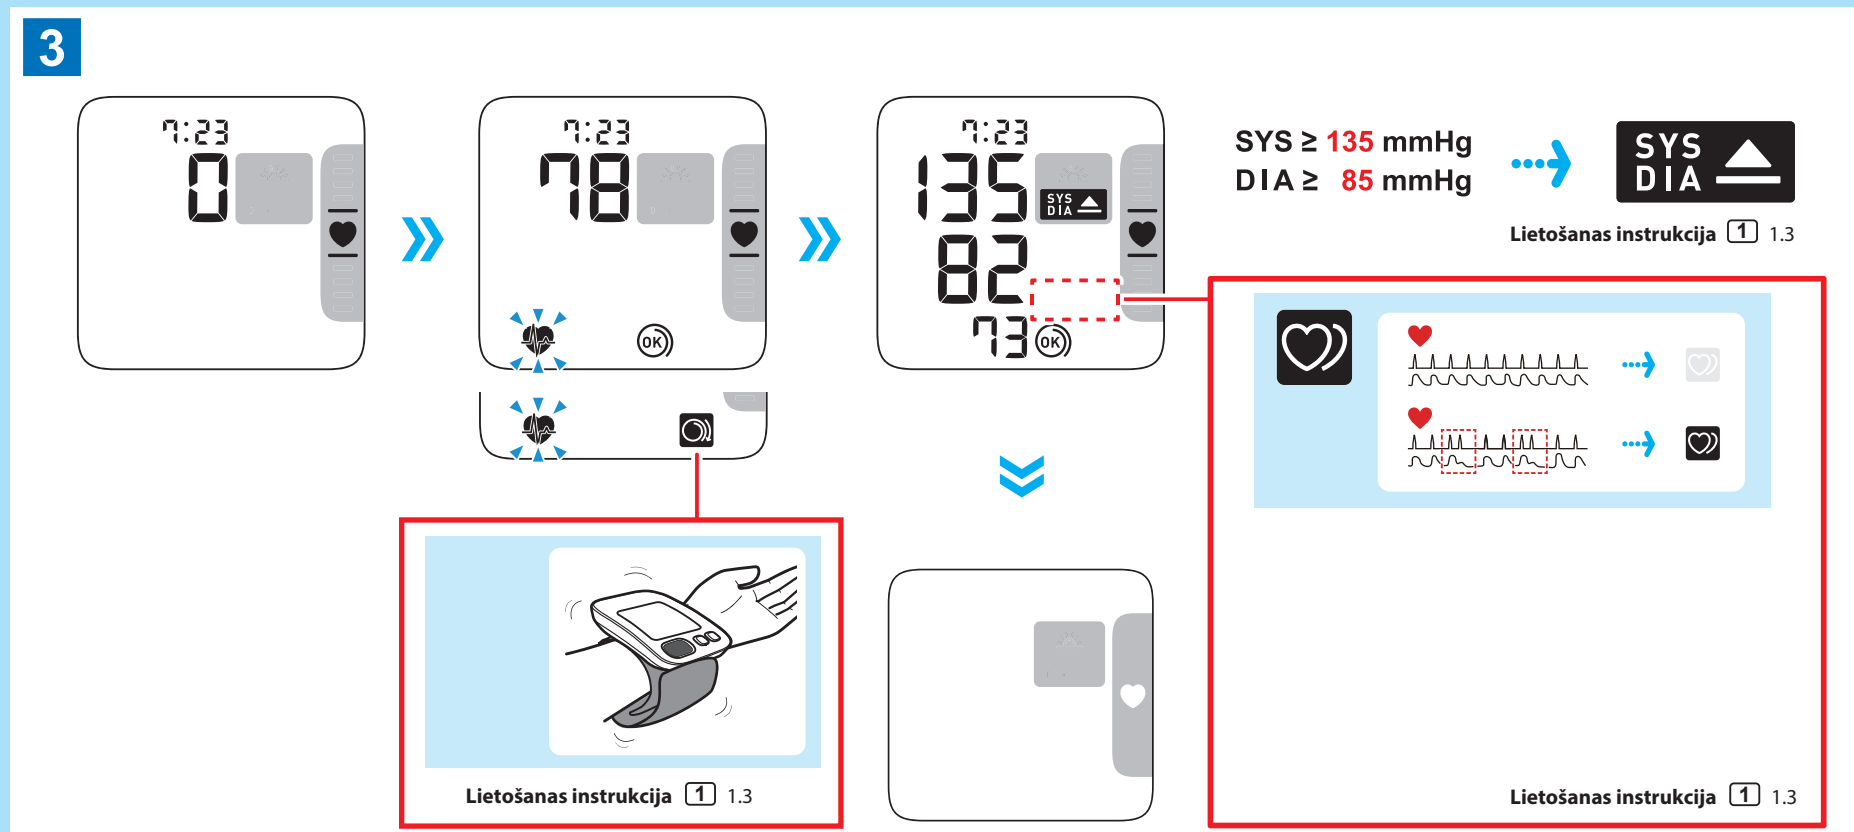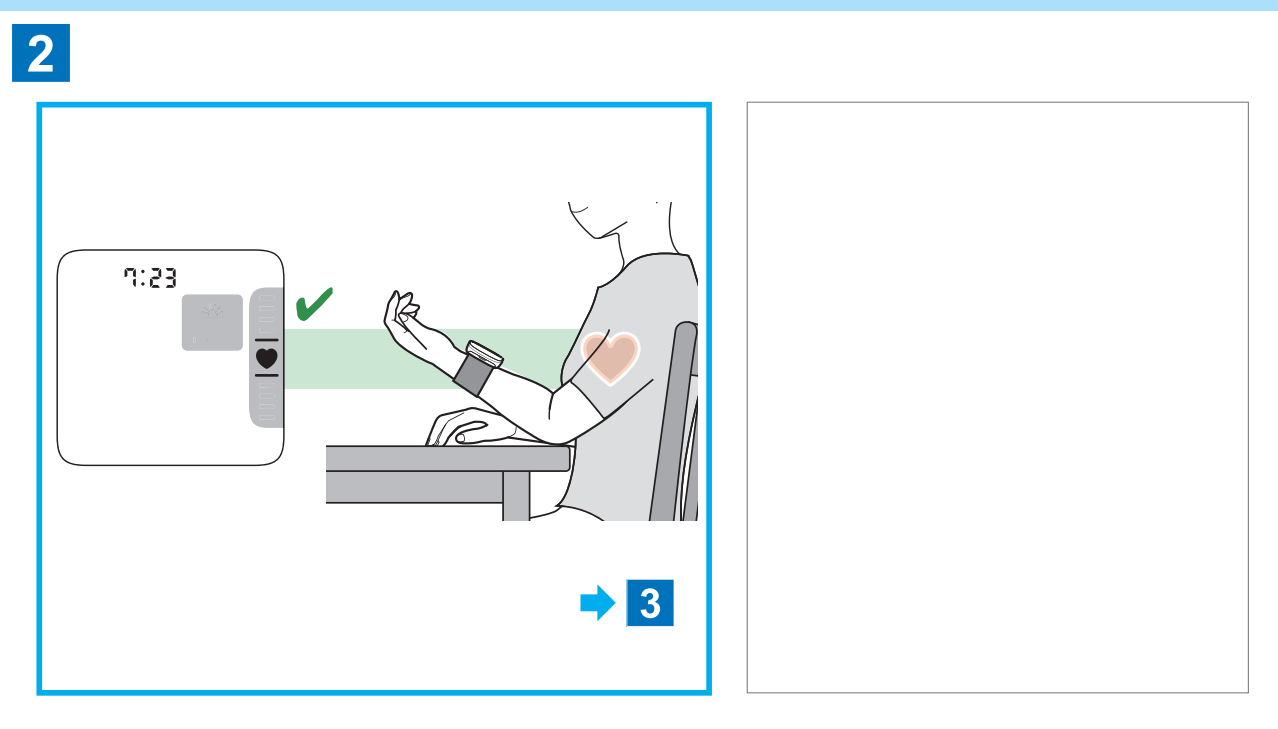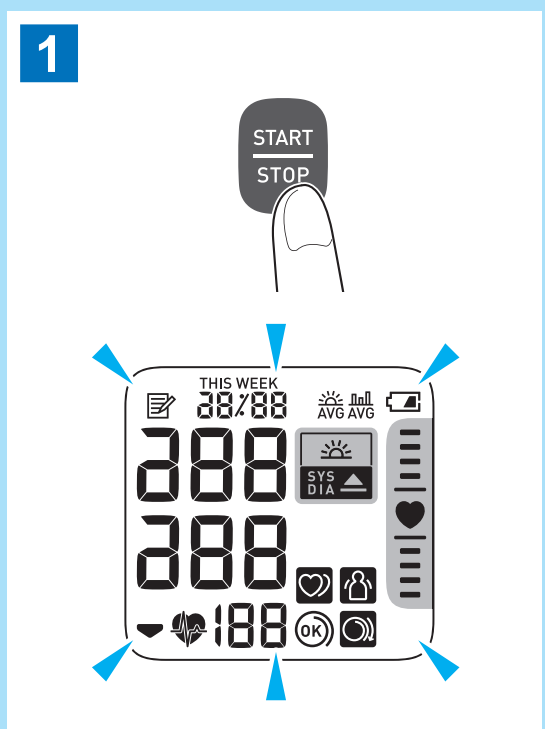




## Atmiņā saglabāto rezultātu skatīšana

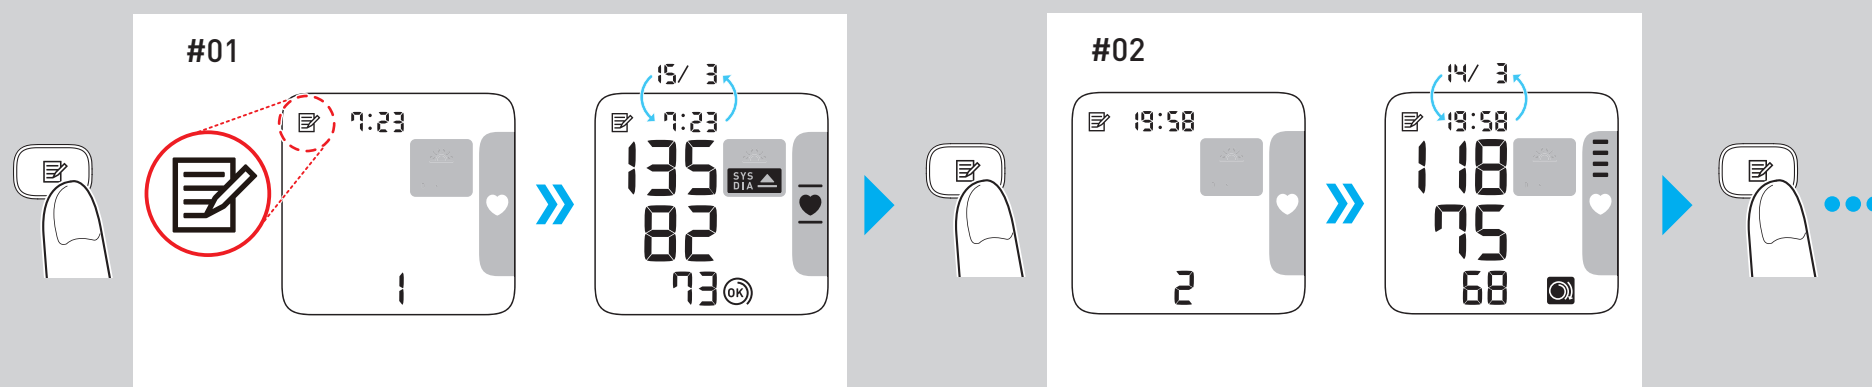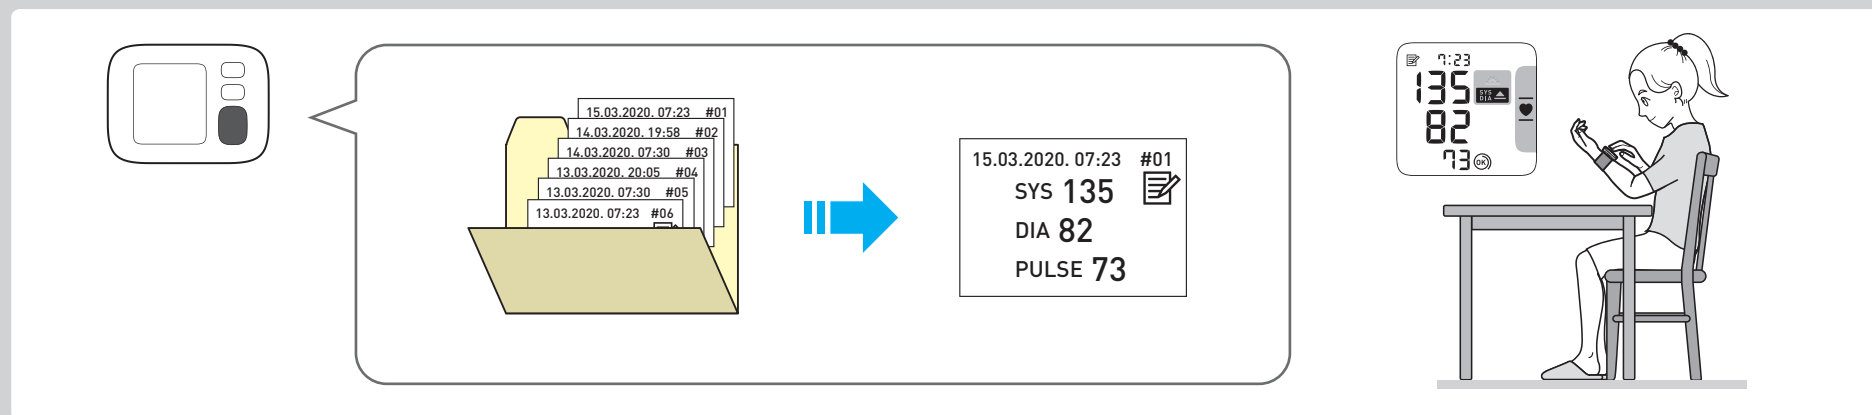

## Visu atmiņā saglabāto rezultātu dzēšana

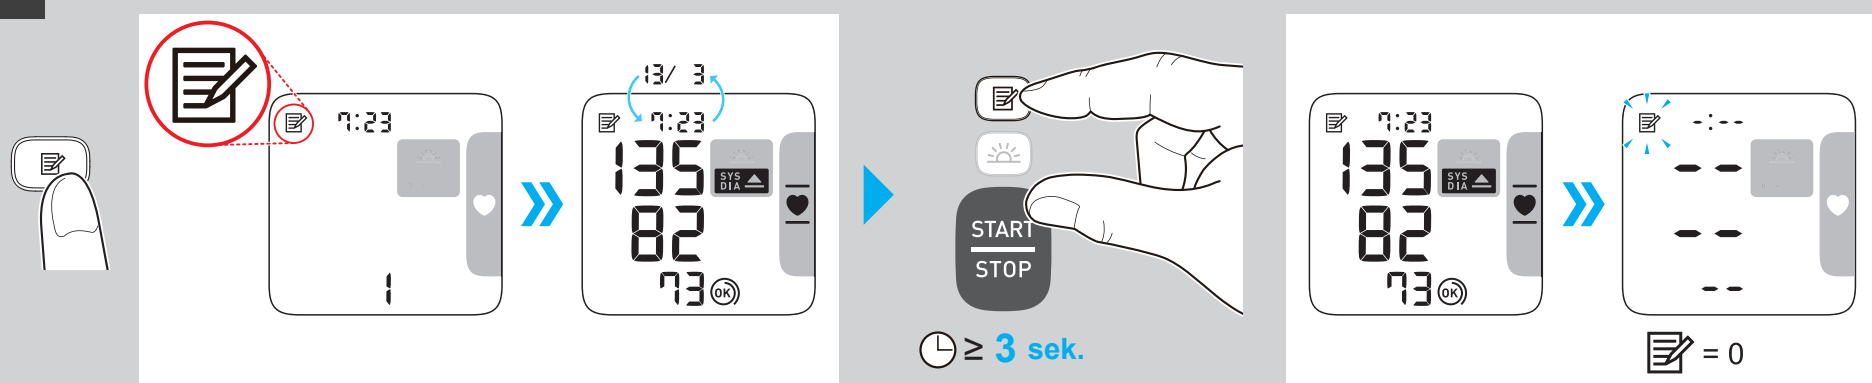

## Sīmbolu apraksts

	Pielietotā daļa — BF tips. Aizsardzība pret elektrotriecienu (strāvas noplūdi)		Temperatūras ierobežojums
	Norāda mēraparāta pareizo novietojumu uz apakšdelma. Izmērāmais apakšdelma apkārtmērs 13.5-21.5cm		Mitruma ierobežojums
IP XX	Aizsardzības klase, ko nosaka standarts IEC 60529		Atmosfēras spiediena ierobežojums
CE	CE marķējums		Lietotājam informācija skatīt lietošanas instrukciju.
UK CA	UKCA marķējums		Lietotājam rūpīgi jāievēro ierīces lietošanas instrukcijā sniegtie norādījumi, lai nodrošinātu tās drošu lietošanu
SN	Sērijas numurs		Baterija / akumulators
UDI	Unikālais ierīces identifikators		Līdzstrāva
MD	Medicīniska ierīce		Ražošanas datums

Ražotājs		<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002, JAPĀNA
ES pārstāvis		<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIDERLANDE www.omron-healthcare.com
Importētājs ES		
Ražotne		<b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong province, Vjetnama
Filiāles	Importētājs un atbildīgā persona Lielbritānijā	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, APVIENOTĀ KARĀLISTE www.omron-healthcare.com/distributors
		<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> www.omron-healthcare.com/distributors
		<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> www.omron-healthcare.com/distributors
Izdošanas datums		2022-06-27