


1

Manual de instruções 2



All for Healthcare

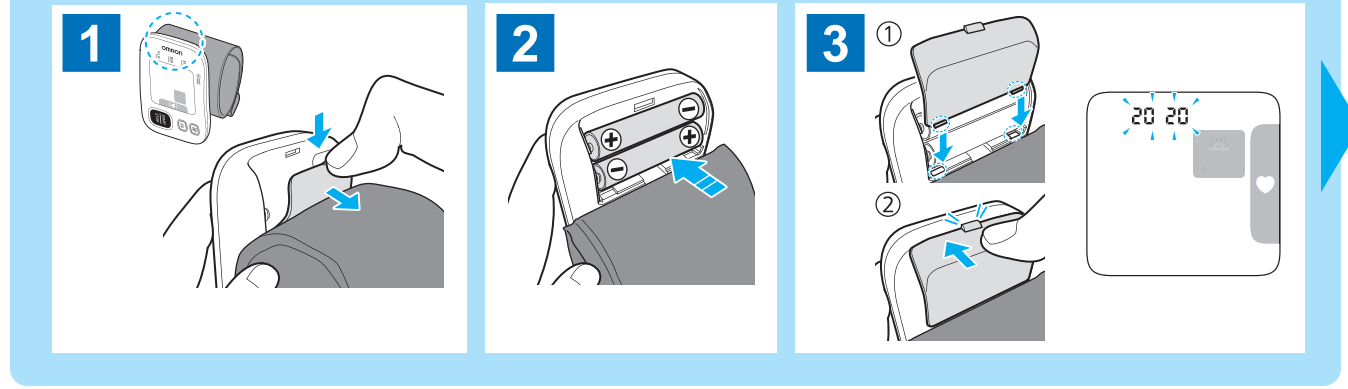


2


Acertar a data e hora






3

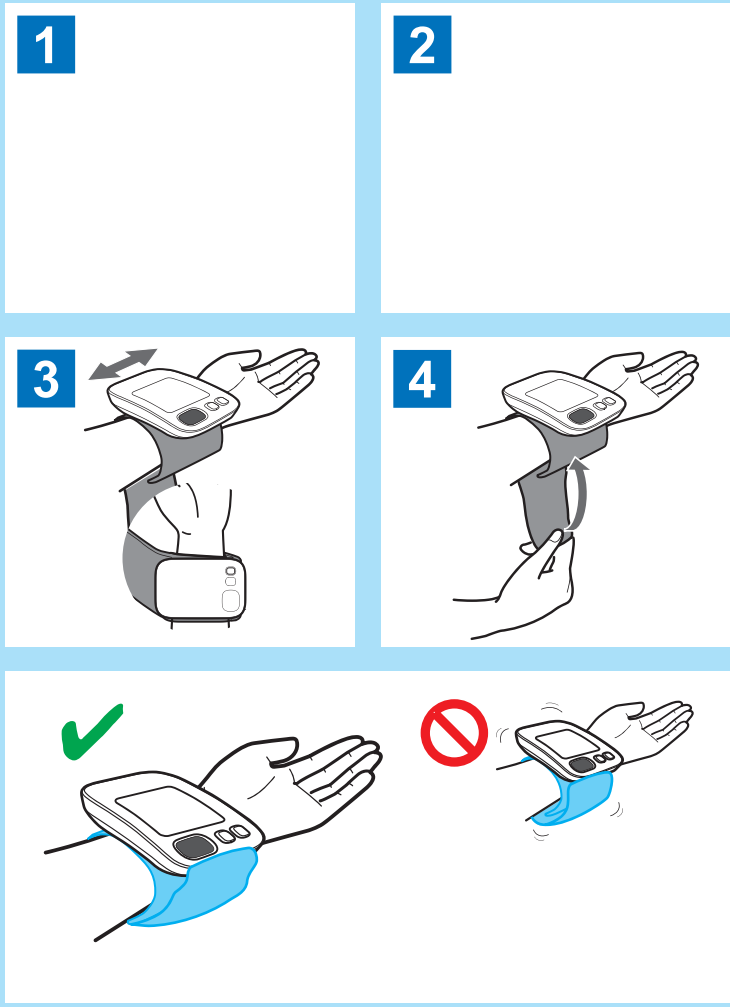

4


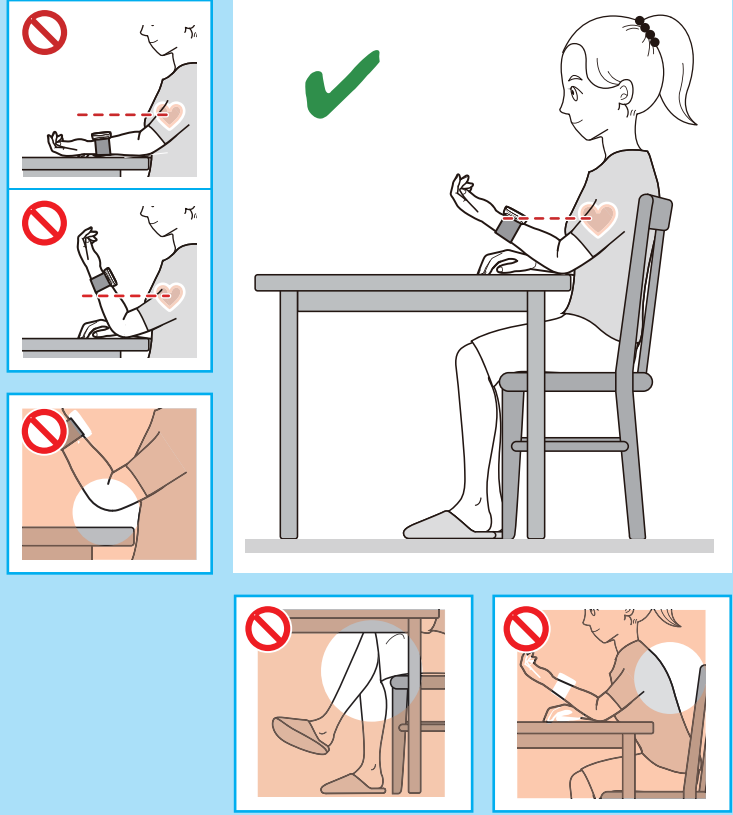


5

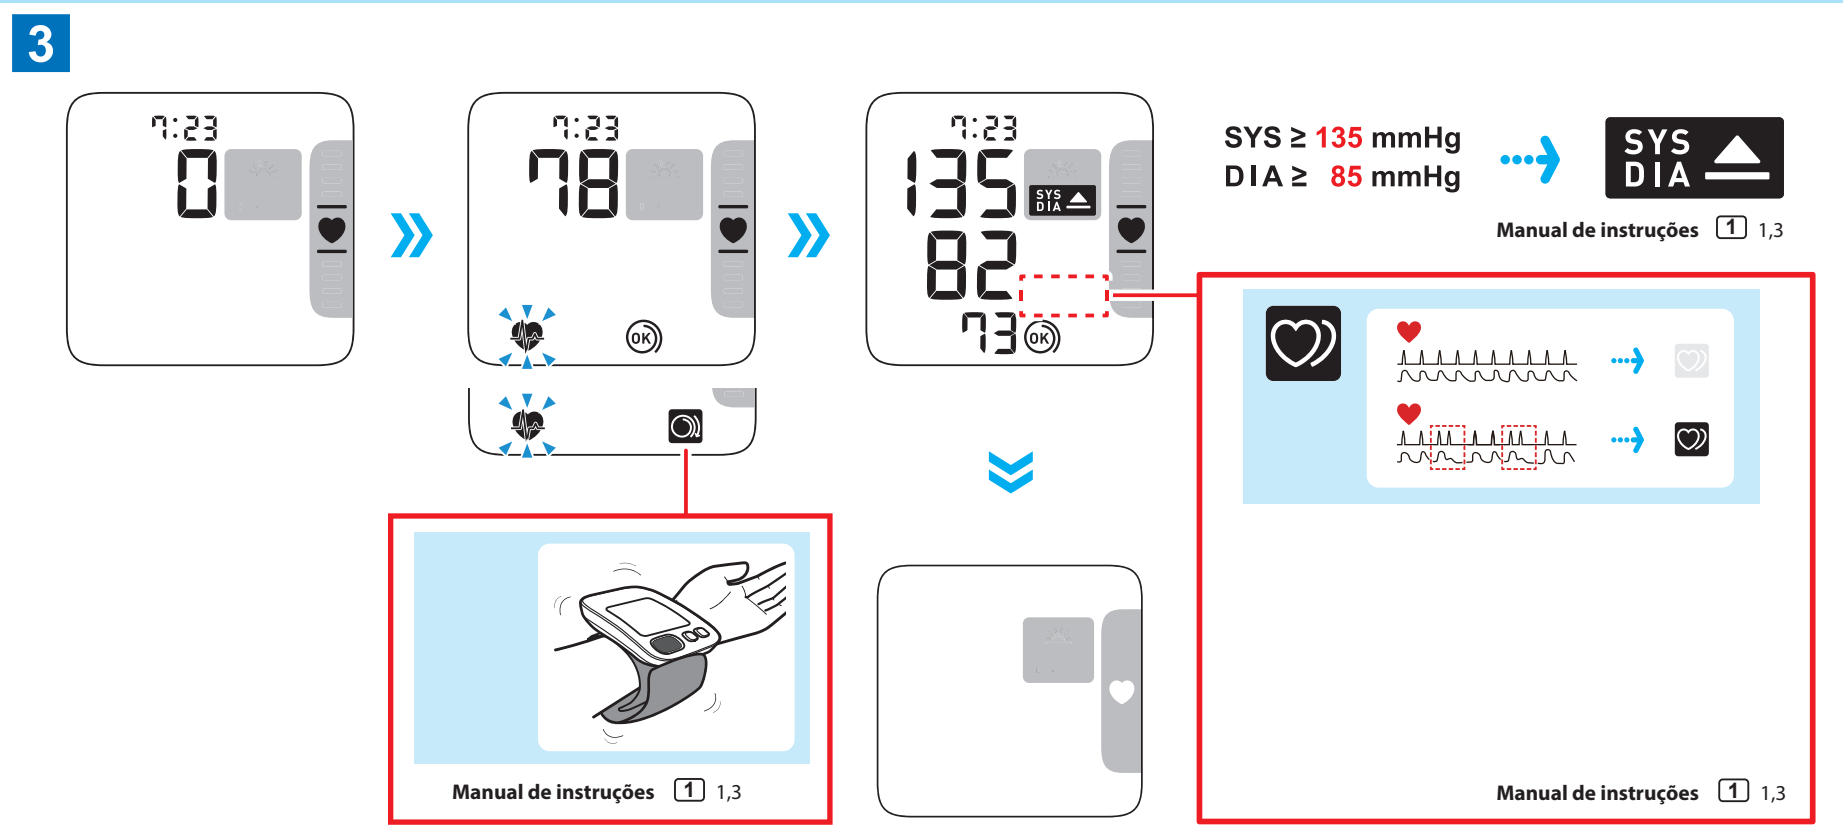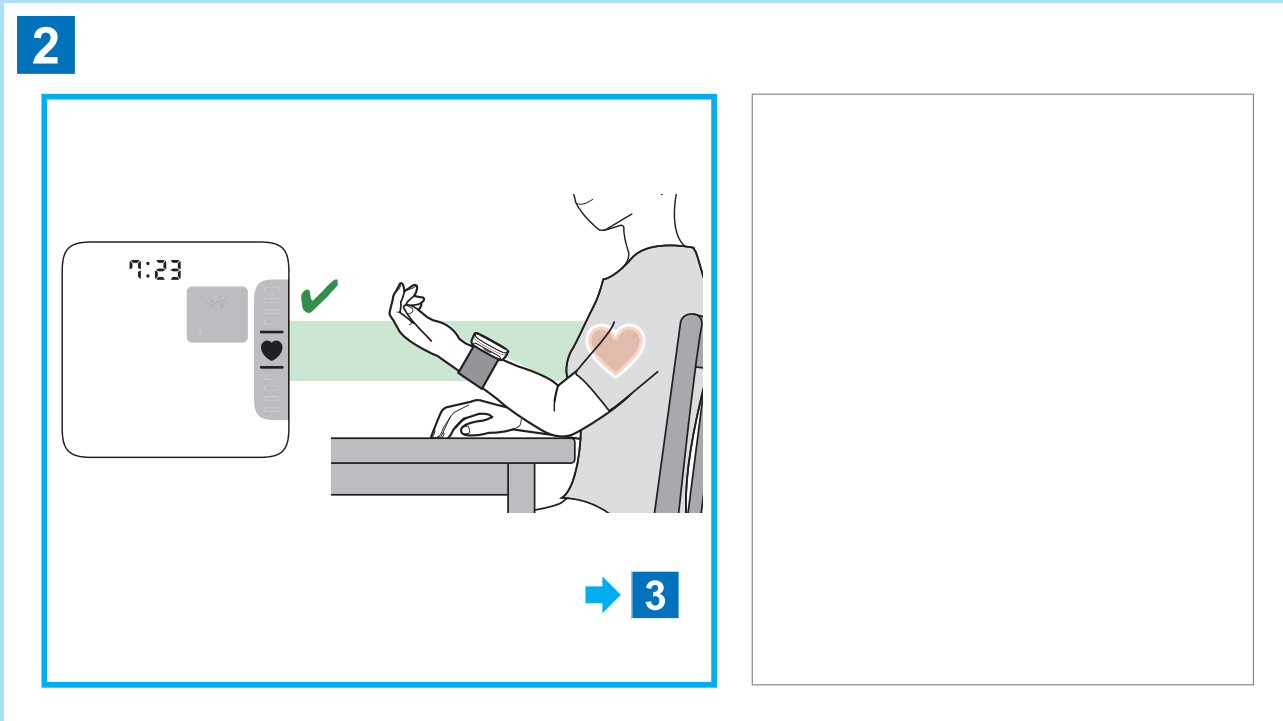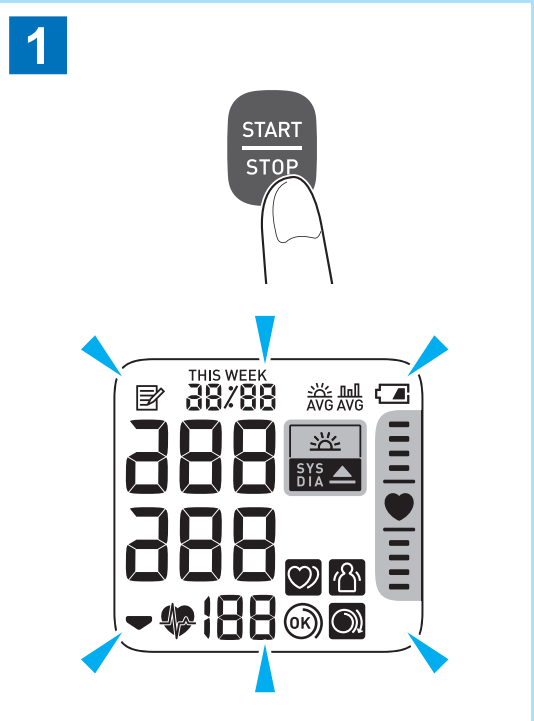




Visualização das leituras guardadas na memória

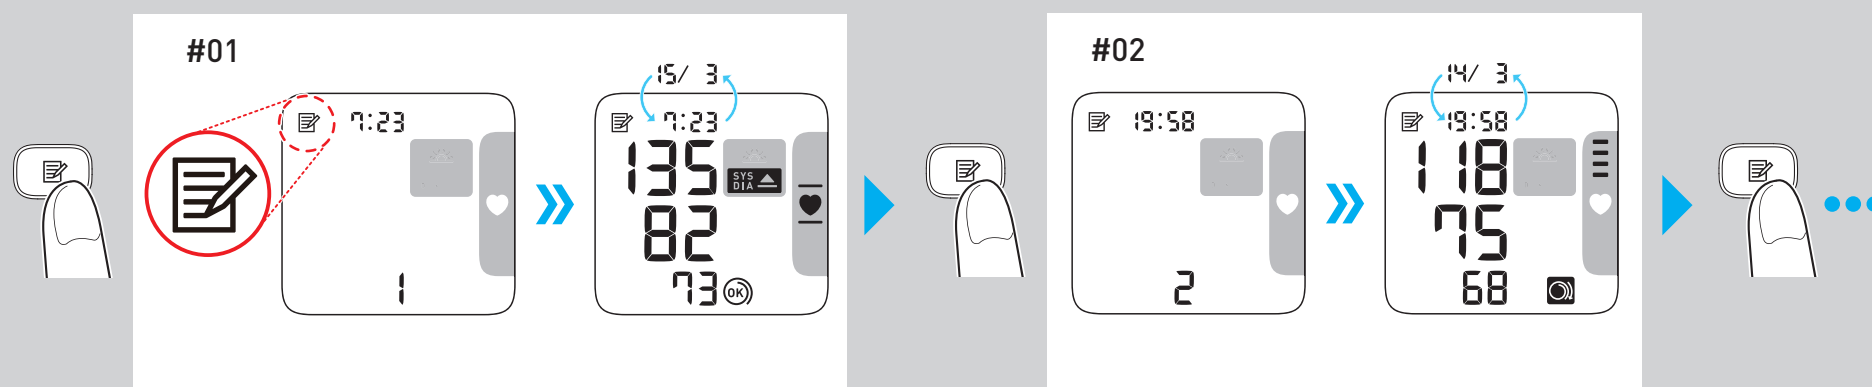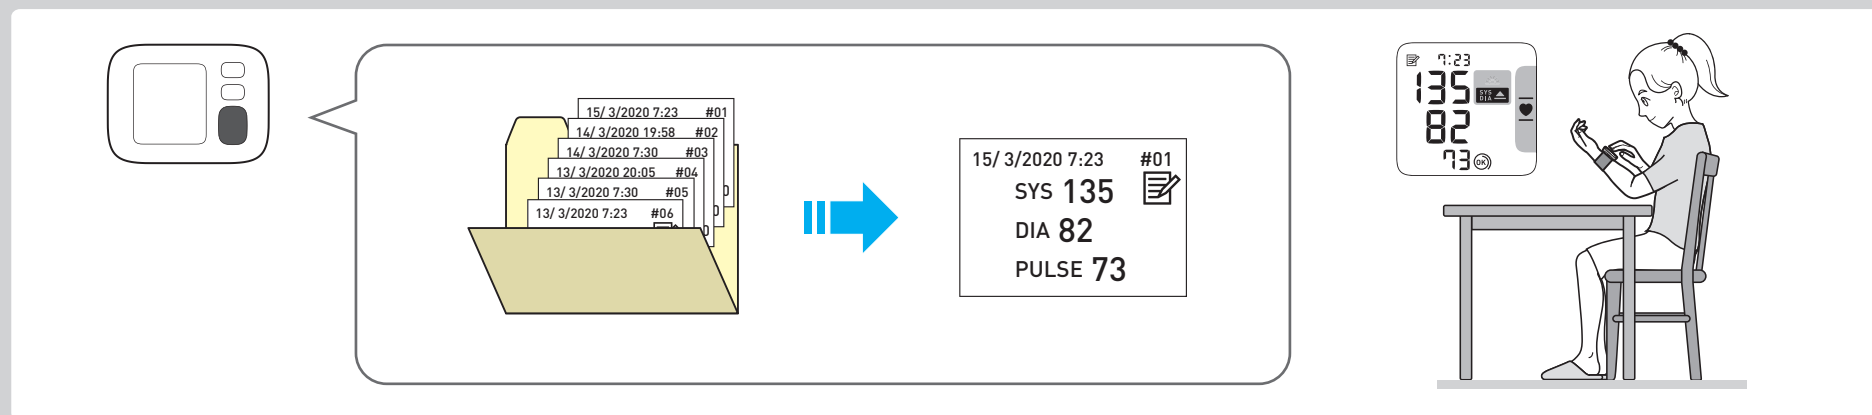

Eliminação de todas as leituras guardadas na memória

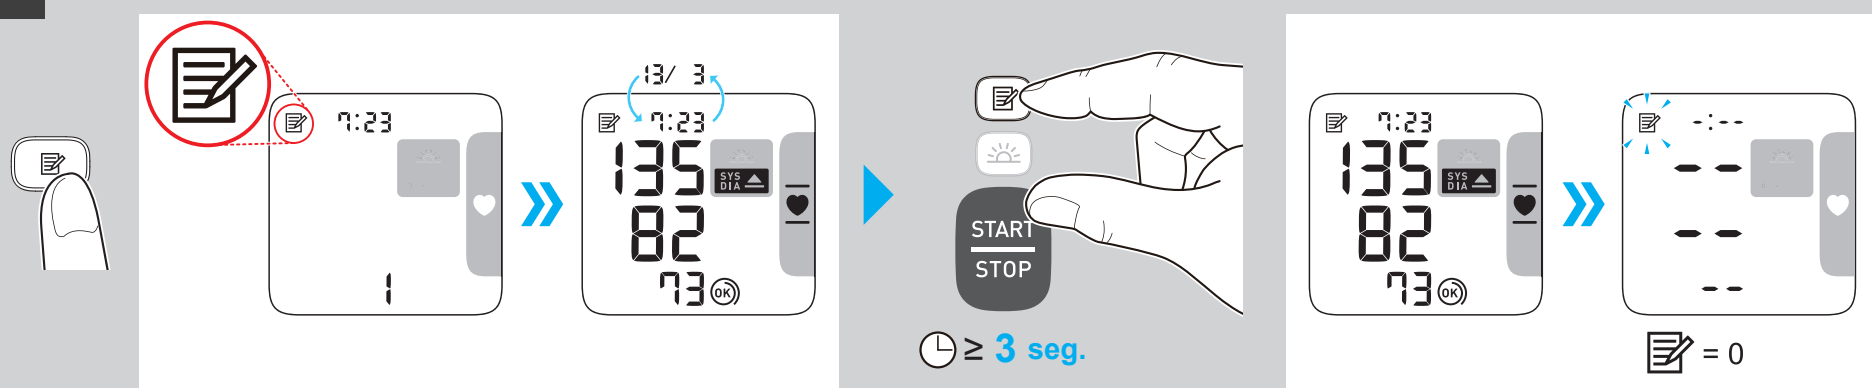

Descrição dos símbolos

	Parte aplicada - Tipo BF: Grau de proteção contra choques elétricos (corrente de fuga)		Limite de temperatura
	Indica o posicionamento correto do medidor no pulso. Circunferência de pulso mensurável 13.5-21.5cm		Limite de humidade
IP XX	Grau de proteção contra entradas indicado pela IEC 60529		Limite de pressão atmosférica
CE	Marca CE		O utilizador tem de consultar este manual de instruções.
UK CA	Marcação UKCA		O utilizador tem de seguir cuidadosamente este manual de instruções para sua própria segurança
SN	Número de série		Bateria/Pilha
UDI	Identificador de dispositivo único		Corrente direta
MD	Dispositivo médico		Data de fabrico

Fabricante		OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPÃO
Representante da UE		OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, PAÍSES BAIXOS www.omron-healthcare.com
Importador na UE		
Local de produção		OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Filiais	Importador no Reino Unido e pessoa responsável no RU	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Data de edição		2022-06-27