





1 Instalação das pilhas

Manual de instruções 2 IM2-HEM-6181-E-PT-05-04/2022




Leia o Manual de instruções (1) e (2) antes de utilizar.

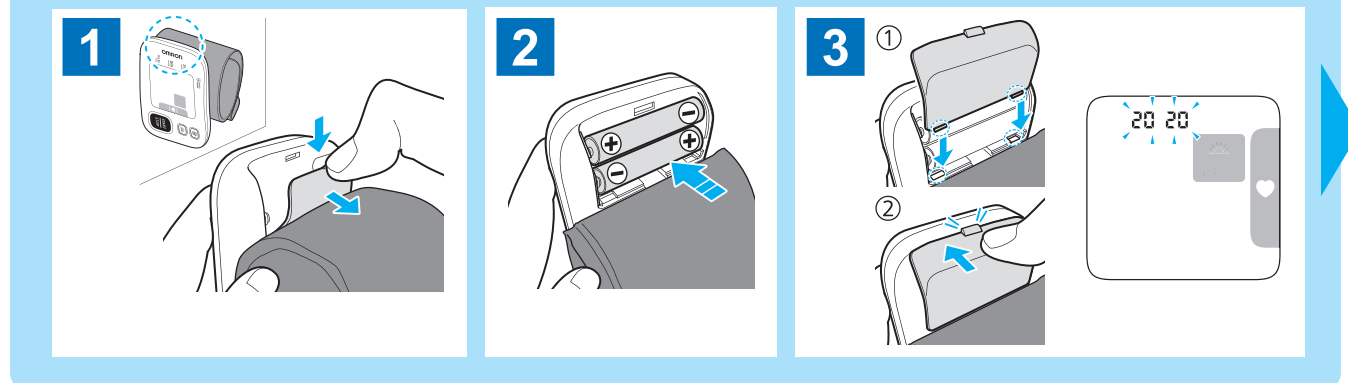

All for Healthcare


2 Acertar a data e hora

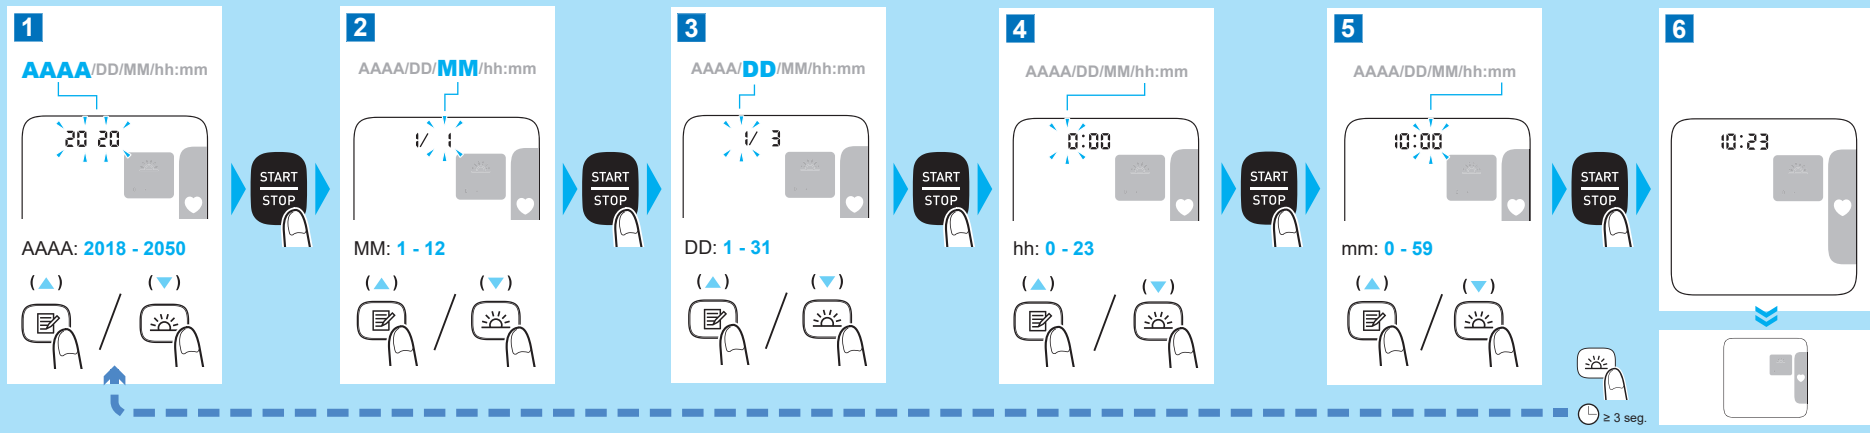


3 Colocação da braçadeira



4 Como sentar-se corretamente


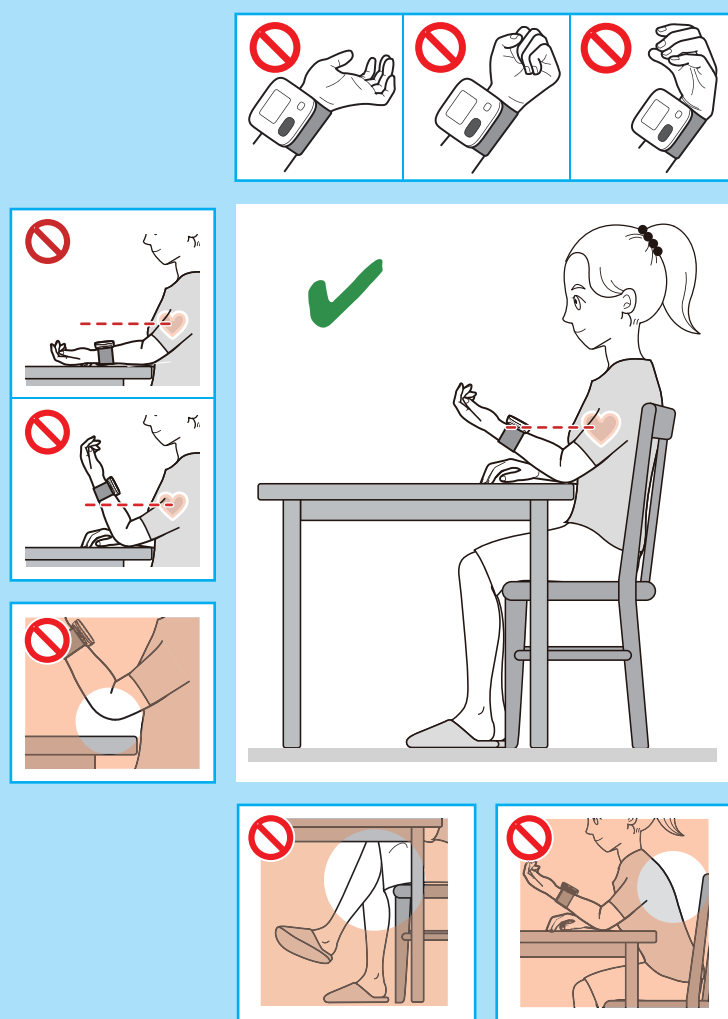


5 Realização de uma medição

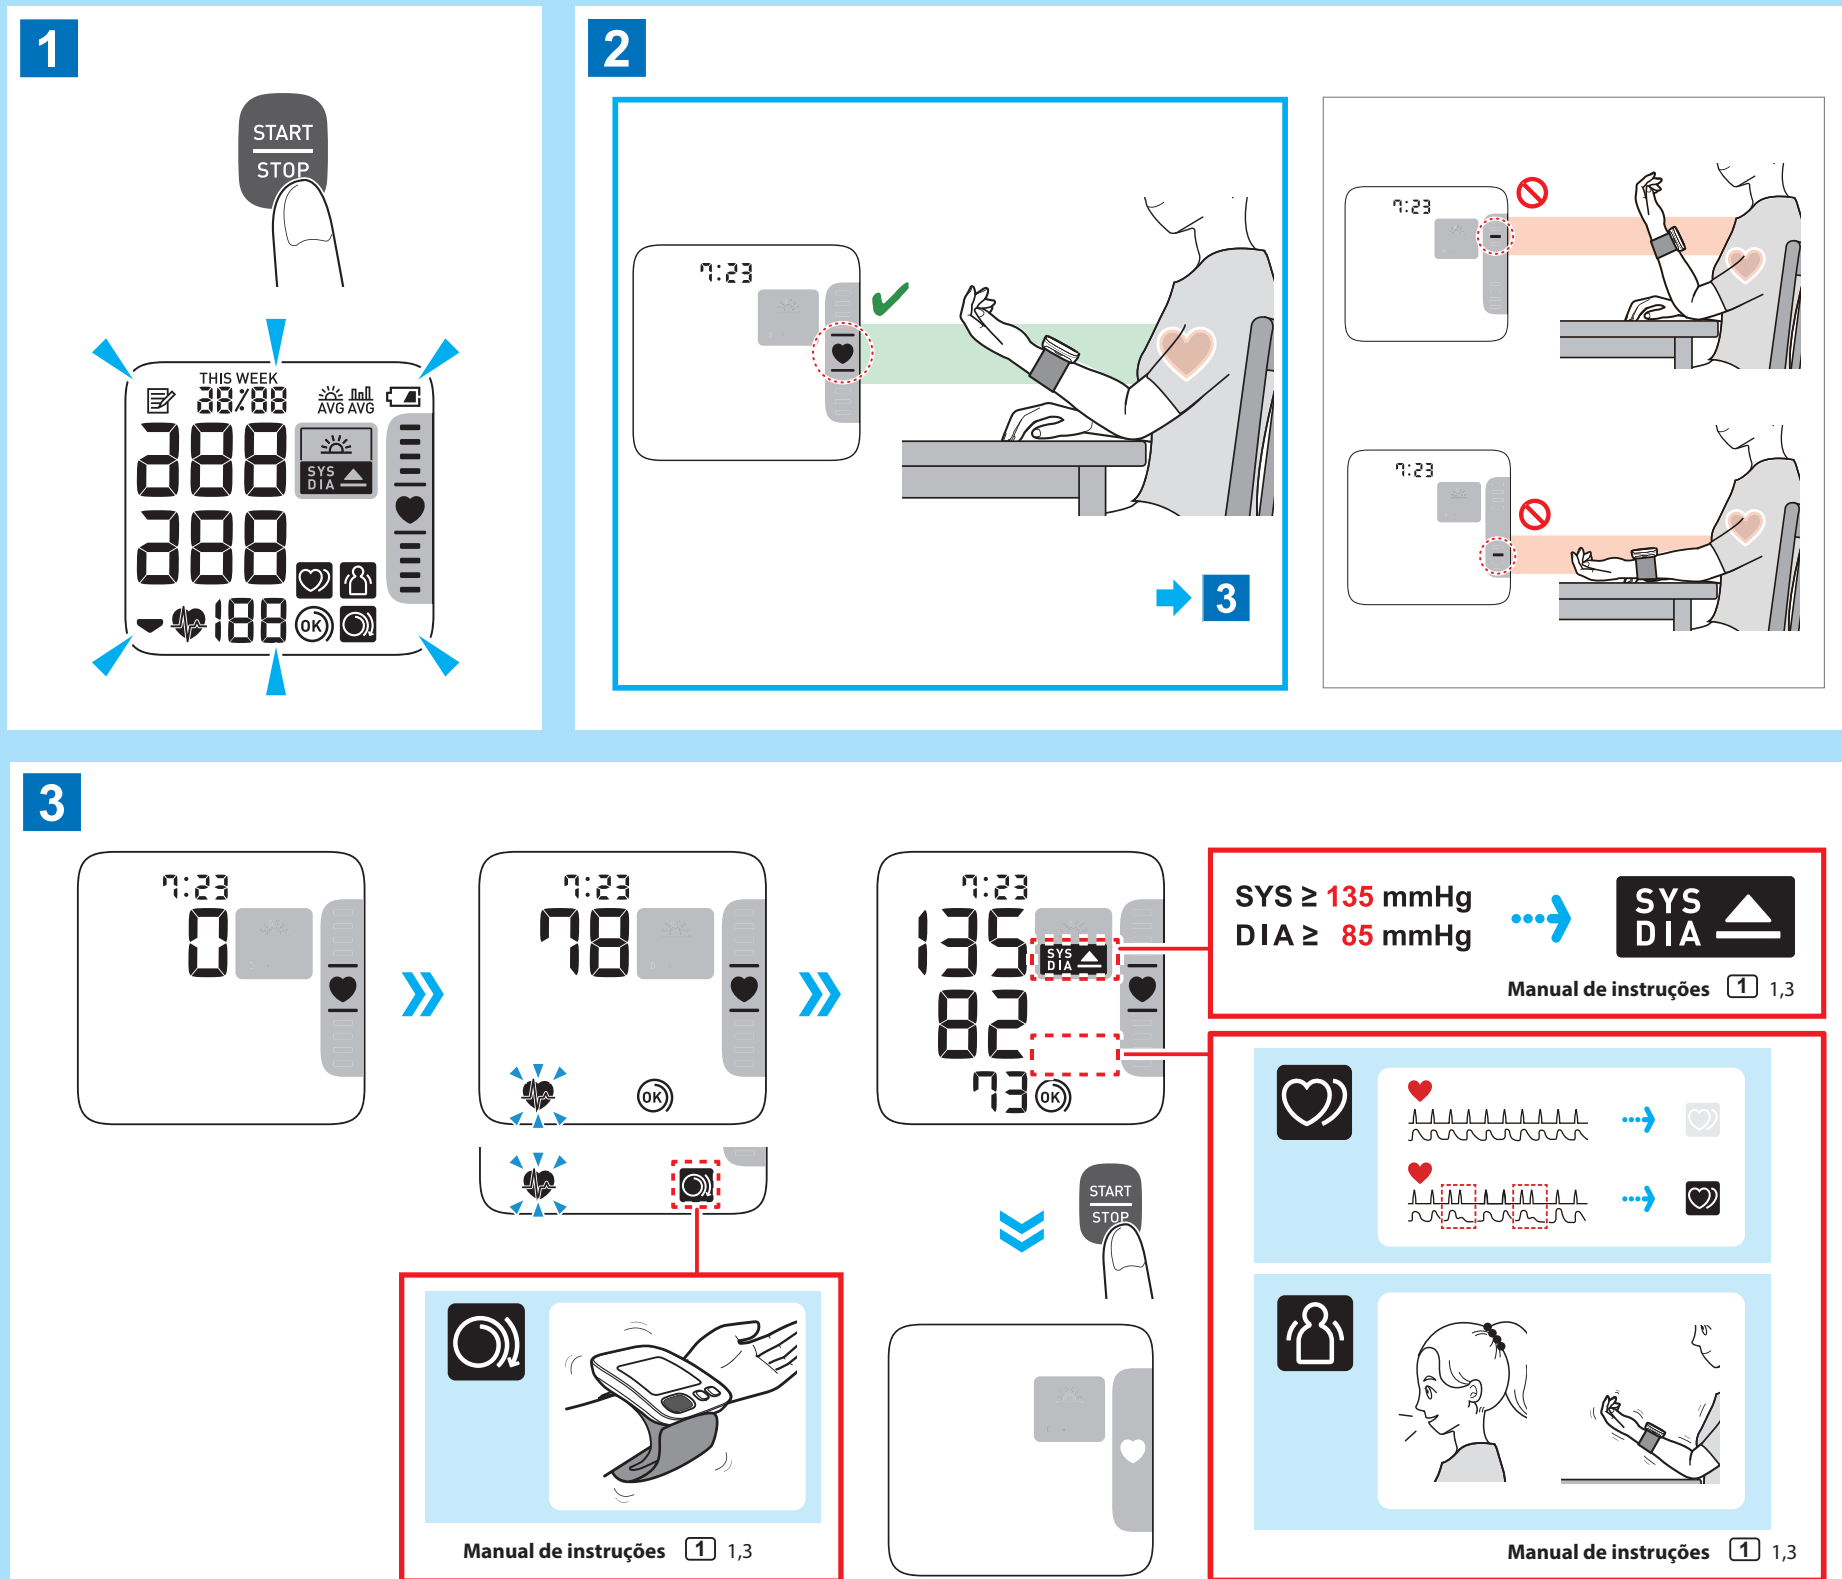




## Visualização das leituras guardadas na memória

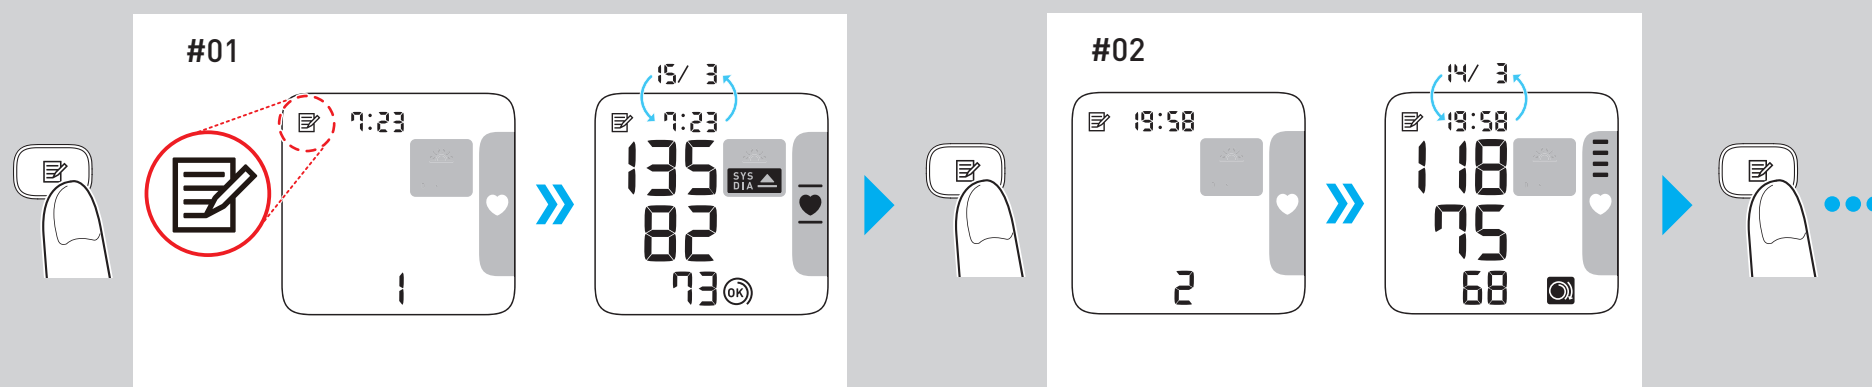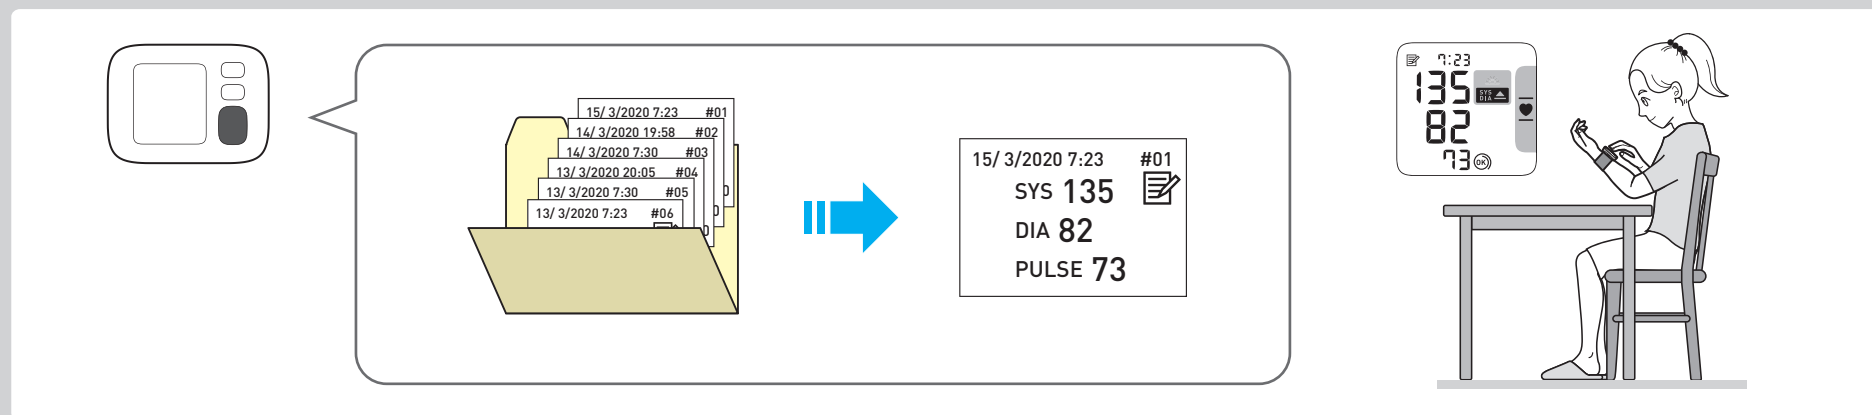

## Eliminação de todas as leituras guardadas na memória

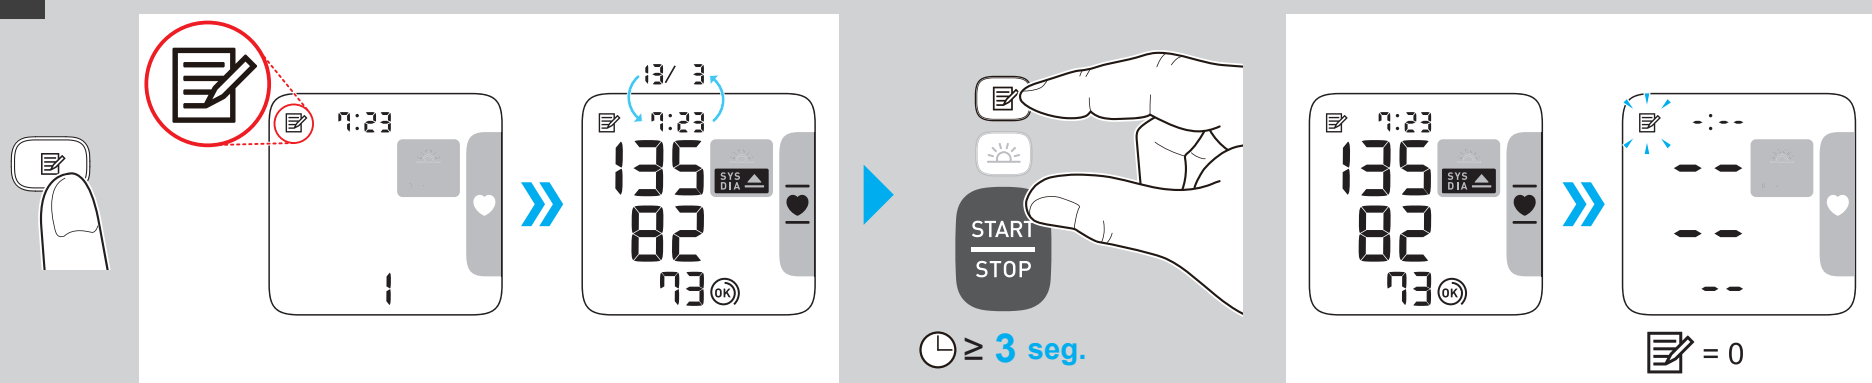

## Descrição dos símbolos

	Parte aplicada - Tipo BF: Grau de proteção contra choques elétricos (corrente de fuga)		Limite de temperatura
	Indica o posicionamento correto do medidor no pulso. Circunferência de pulso mensurável 13.5-21.5cm		Limite de humidade
IP XX	Grau de proteção contra entradas indicado pela IEC 60529		Limite de pressão atmosférica
CE	Marca CE		O utilizador tem de consultar este manual de instruções.
UK CA	Marcação UKCA		O utilizador tem de seguir cuidadosamente este manual de instruções para sua própria segurança
SN	Número de série		Bateria/Pilha
UDI	Identificador de dispositivo único		Corrente direta
MD	Dispositivo médico		Data de fabrico

Fabricante		<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPÃO
Representante da UE		<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, PAÍSES BAIXOS www.omron-healthcare.com
Importador na UE		
Local de produção		<b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Filiais	Importador no Reino Unido e pessoa responsável no RU	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> www.omron-healthcare.com/distributors
		<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> www.omron-healthcare.com/distributors
Data de edição		2022-06-27