


1 Inštalácia batérií


Návod na obsluhu 2

IM2-HEM-6181-E-SK-05-04/2022




Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu 1 a 2.


All for Healthcare

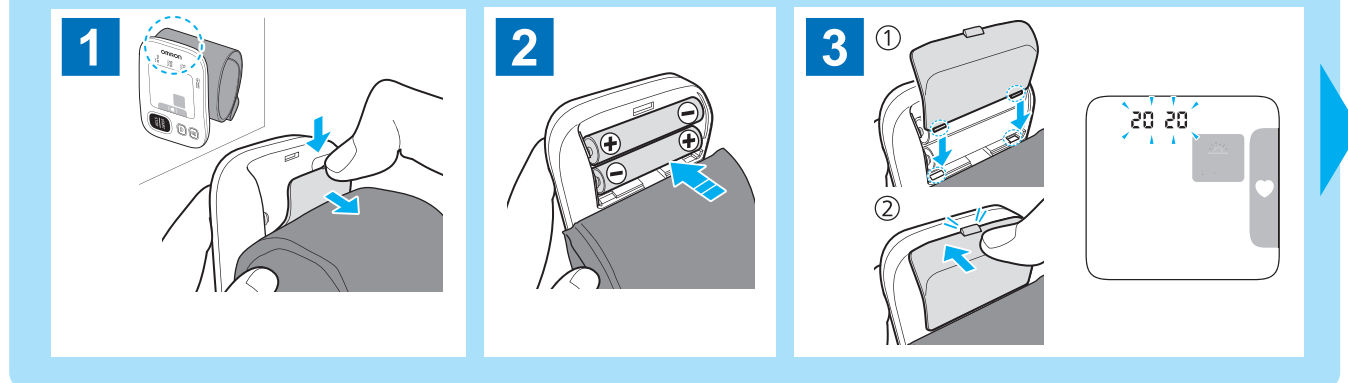


2 Nastavenie dátumu a času

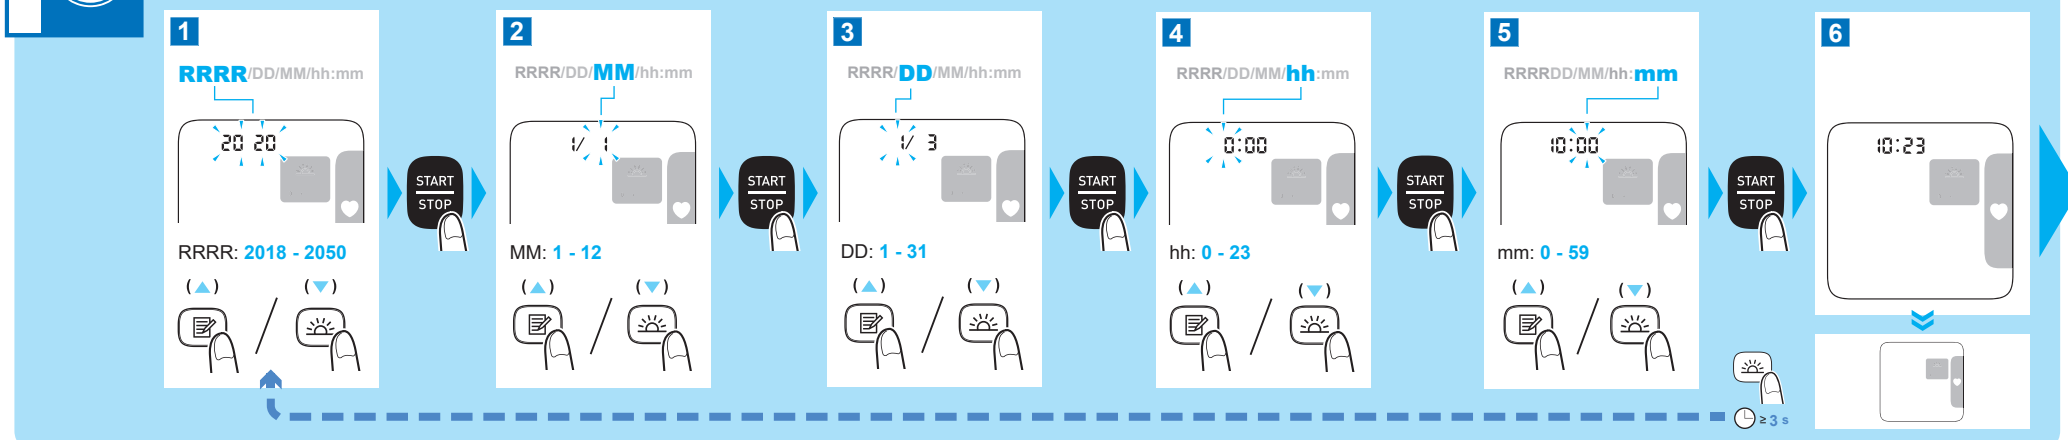


3 Nasadenie zápästnej manžety

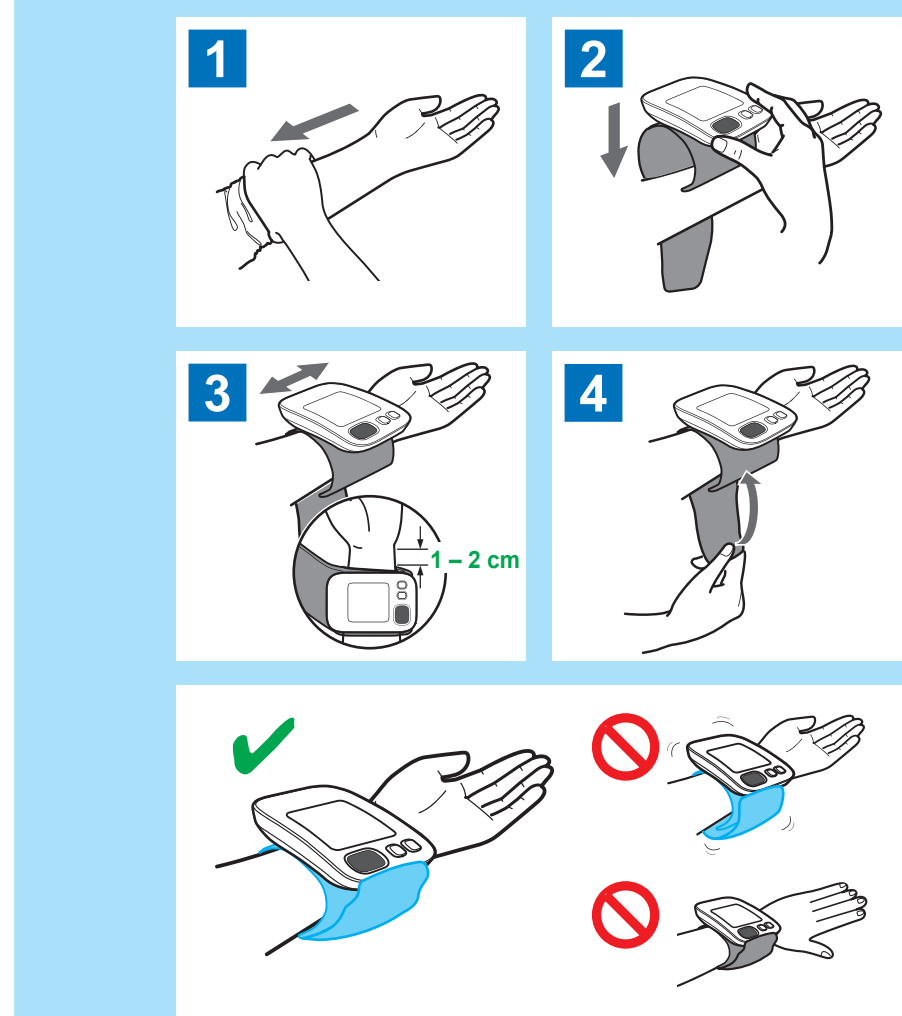

4 Správne sedenie


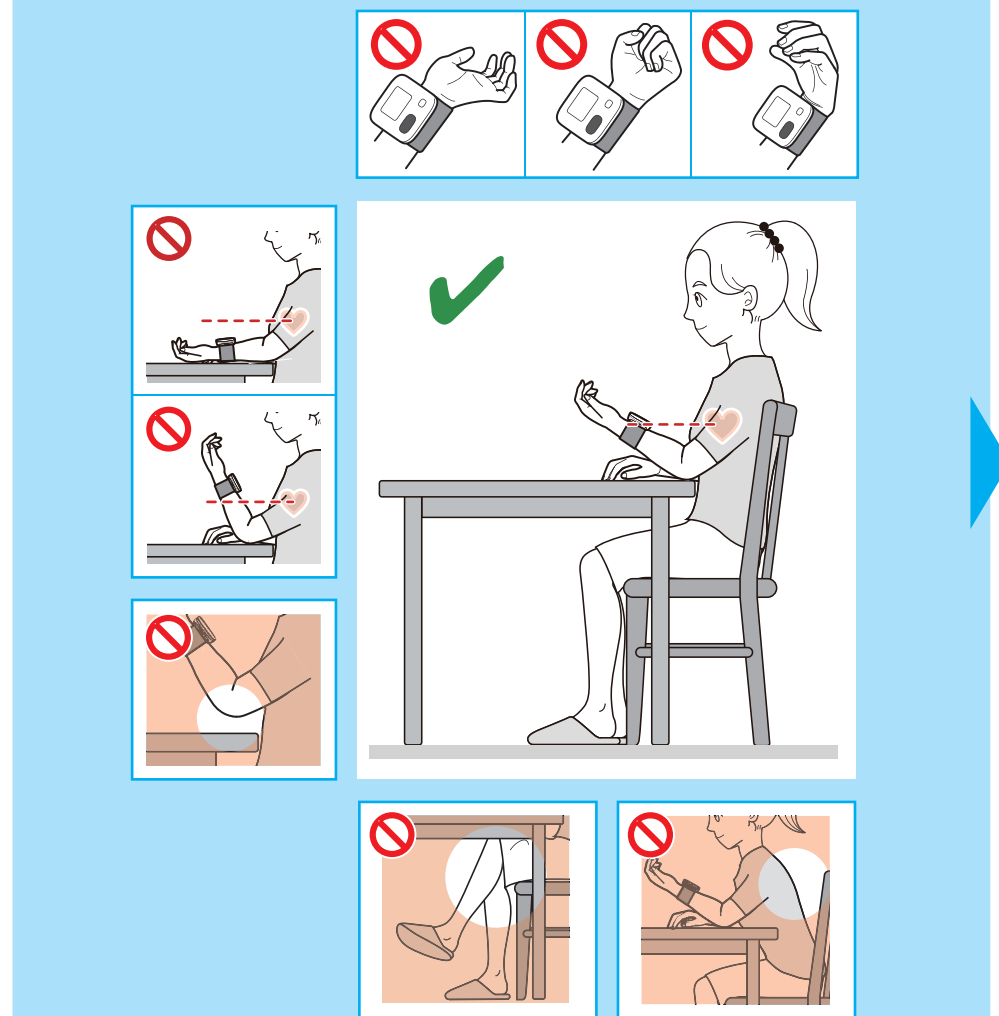


5 Meranie tlaku krvi

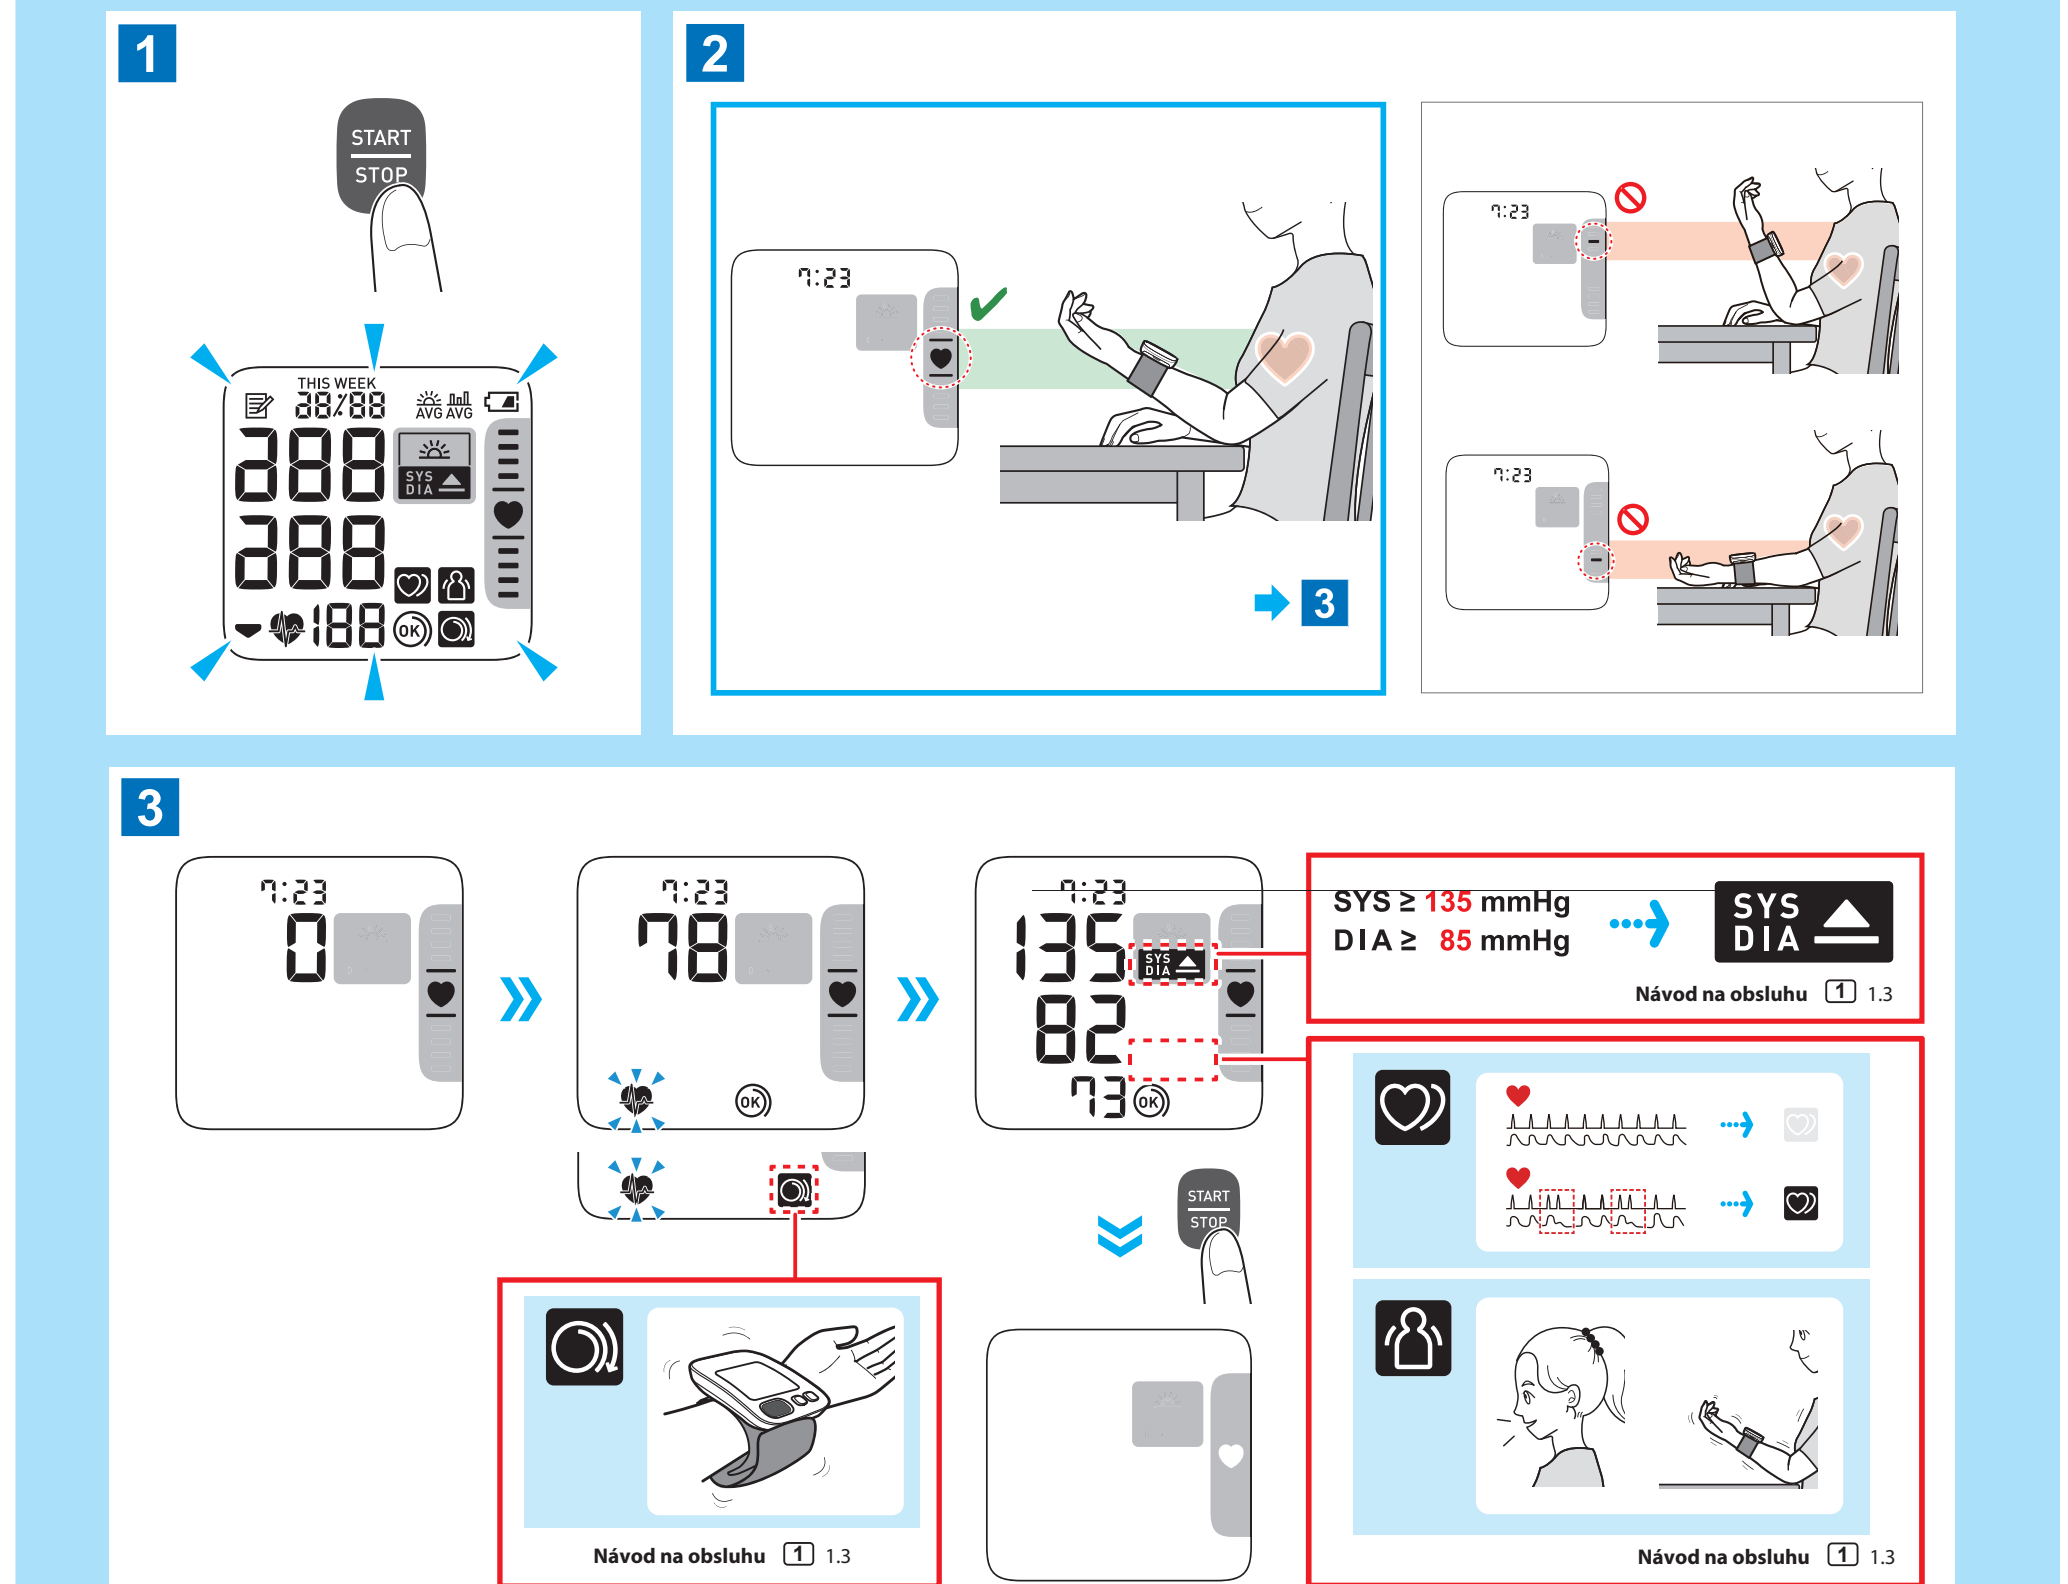




Prezeranie výsledkov merania uložených v pamäti

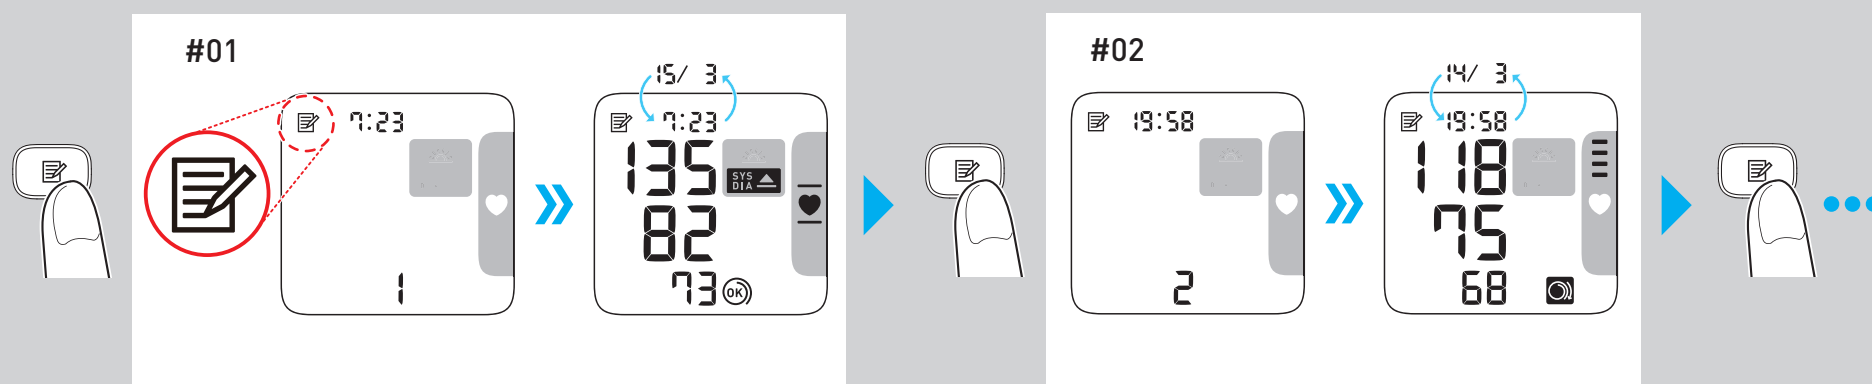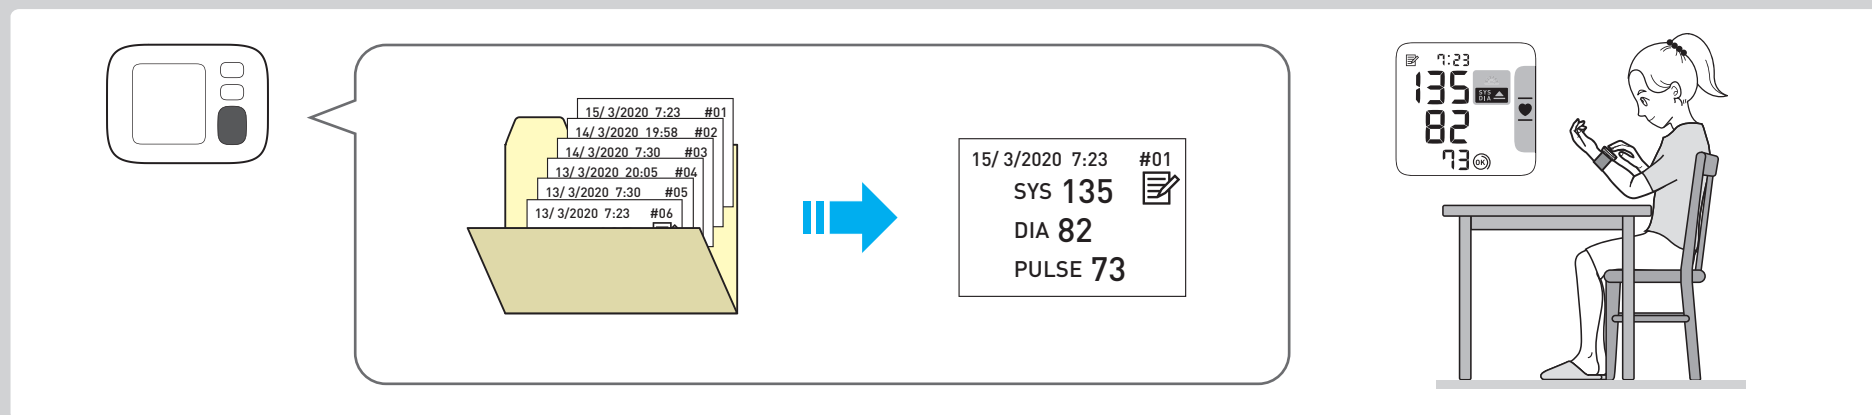

Vymazanie všetkých výsledkov merania uložených v pamäti

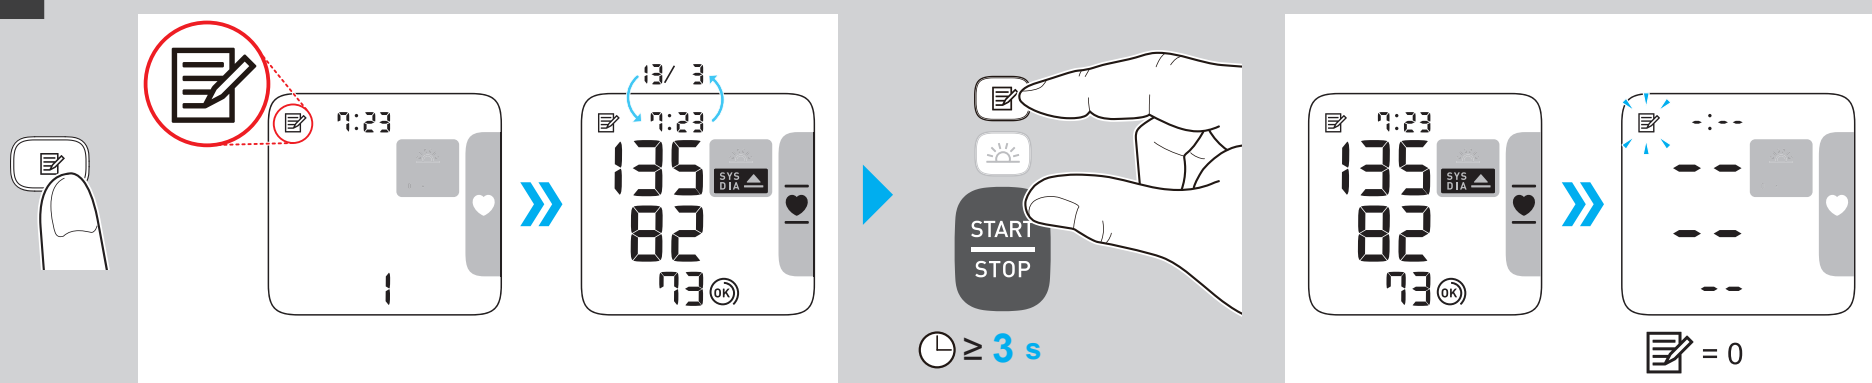

Opis symbolov

	Pripojená časť – Typ BF: Stupeň ochrany pred zásahom elektrickým prúdom (zvodovým prúdom)		Teplotné obmedzenie
	Určuje správnu polohu merača na zápästí. Merateľný obvod zápästia 13.5-21.5cm		Vlhkostné obmedzenie
IP XX	Stupeň ochrany proti vniknutiu podľa IEC 60529		Obmedzenie atmosférického tlaku
CE	Označenie CE		Je potrebné, aby používateľ nahliadol do tohoto návodu na použitie.
UK CA	Certifikácia UKCA		Je potrebné, aby používateľ z dôvodu vlastnej bezpečnosti presne dodržiaval tento návod na použitie.
SN	Sériové číslo		Batéria/blok
UDI	Unikátny identifikátor pomôcky (UDI)		Jednosmerný prúd
MD	Zdravotnícka pomôcka		Dátum výroby

Výrobca 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zastúpenie v EÚ 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANSKO www.omron-healthcare.com
Dovozca pre EÚ	
Výrobná prevádzka	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Dcérske spoločnosti	Dovozca pre Spojené kráľovstvo a zodpovedná osoba v UK OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Dátum vydania	2022-06-27