




1

Návod na obsluhu 2

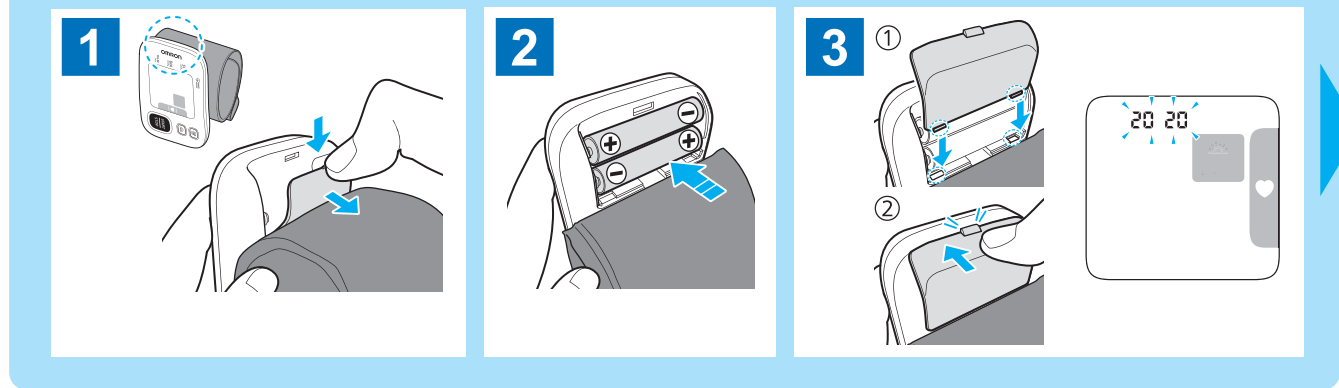


All for Healthcare

2


Nastavenie dátumu a času






3

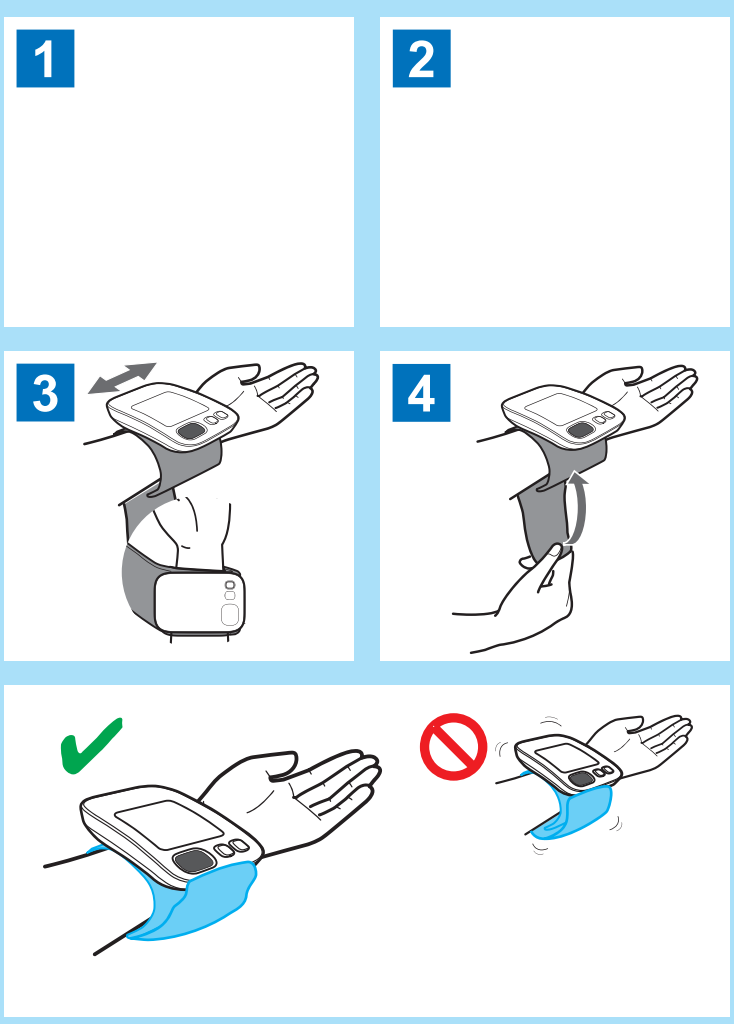

4


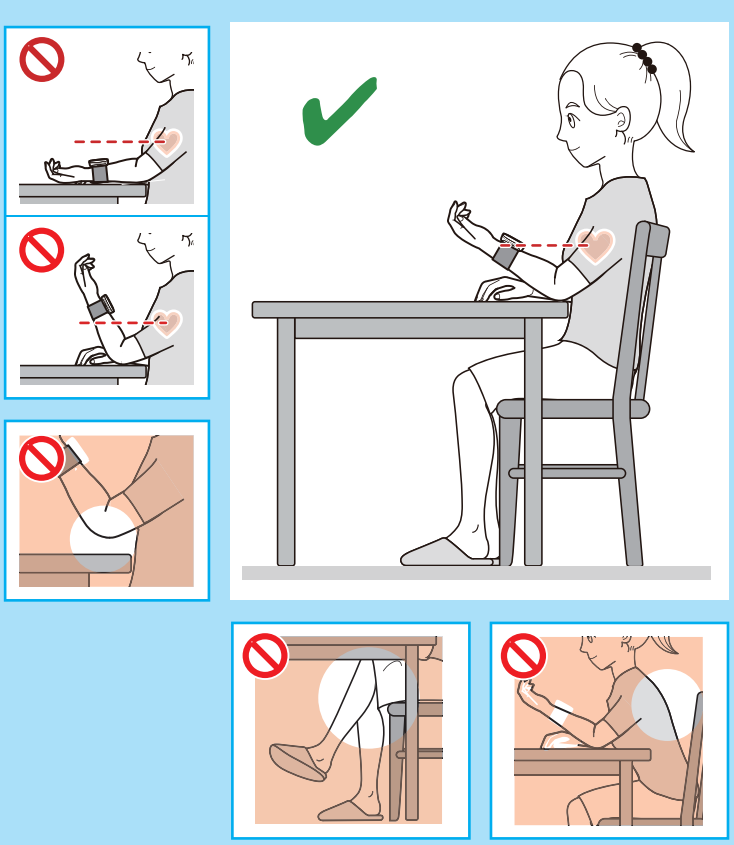


5

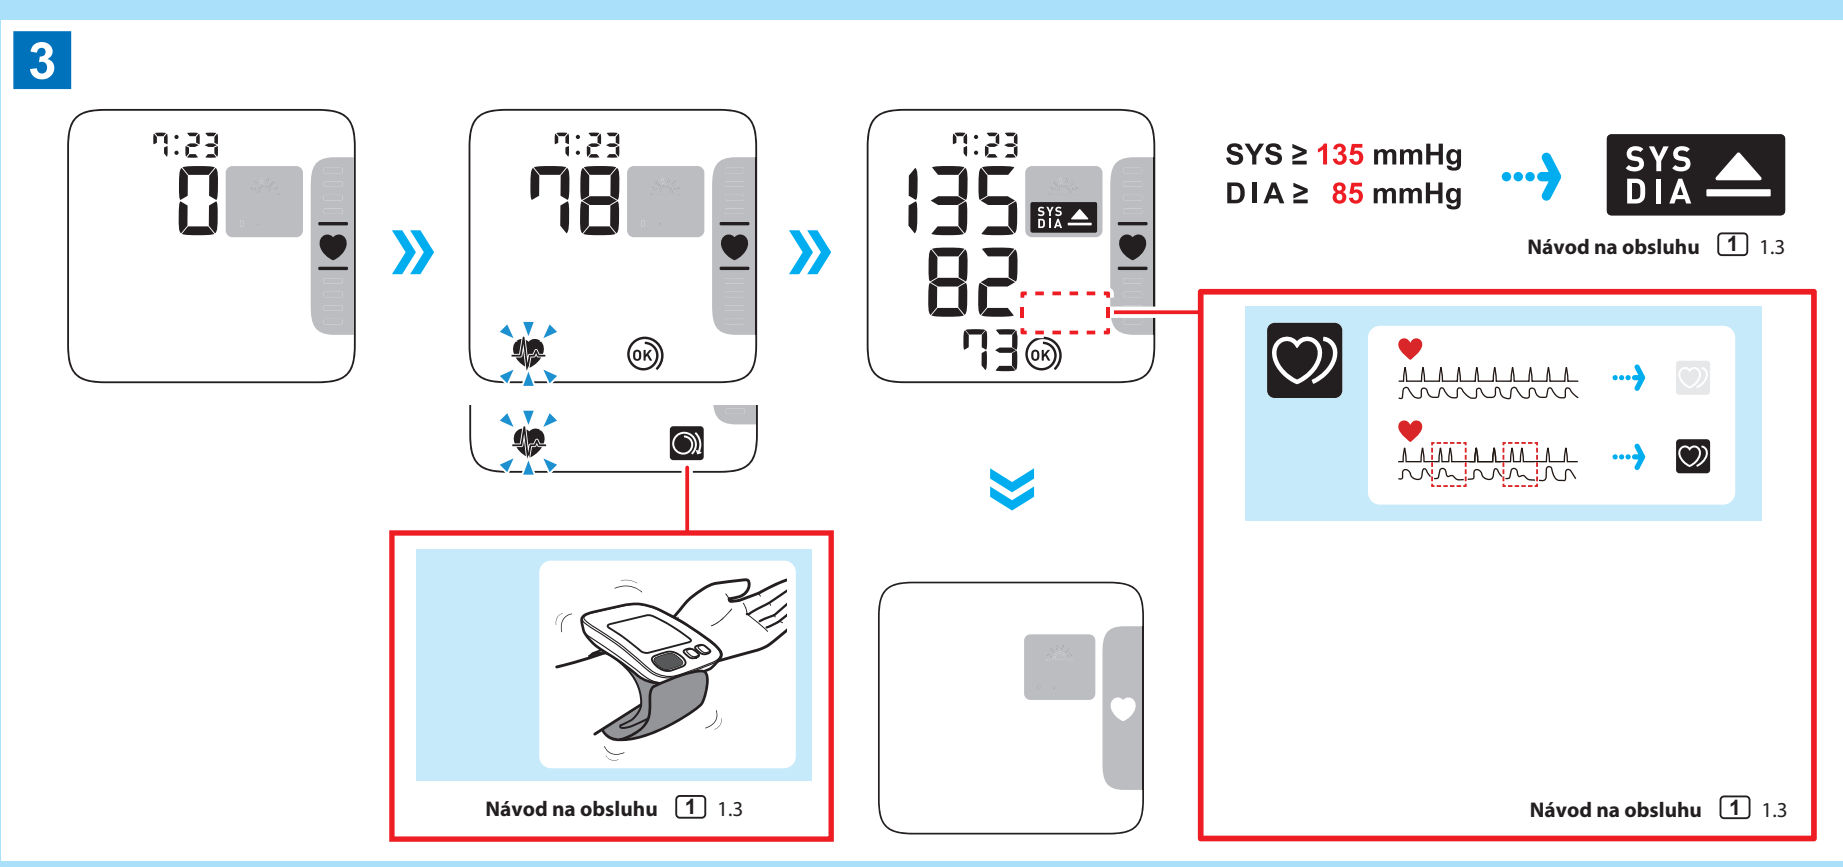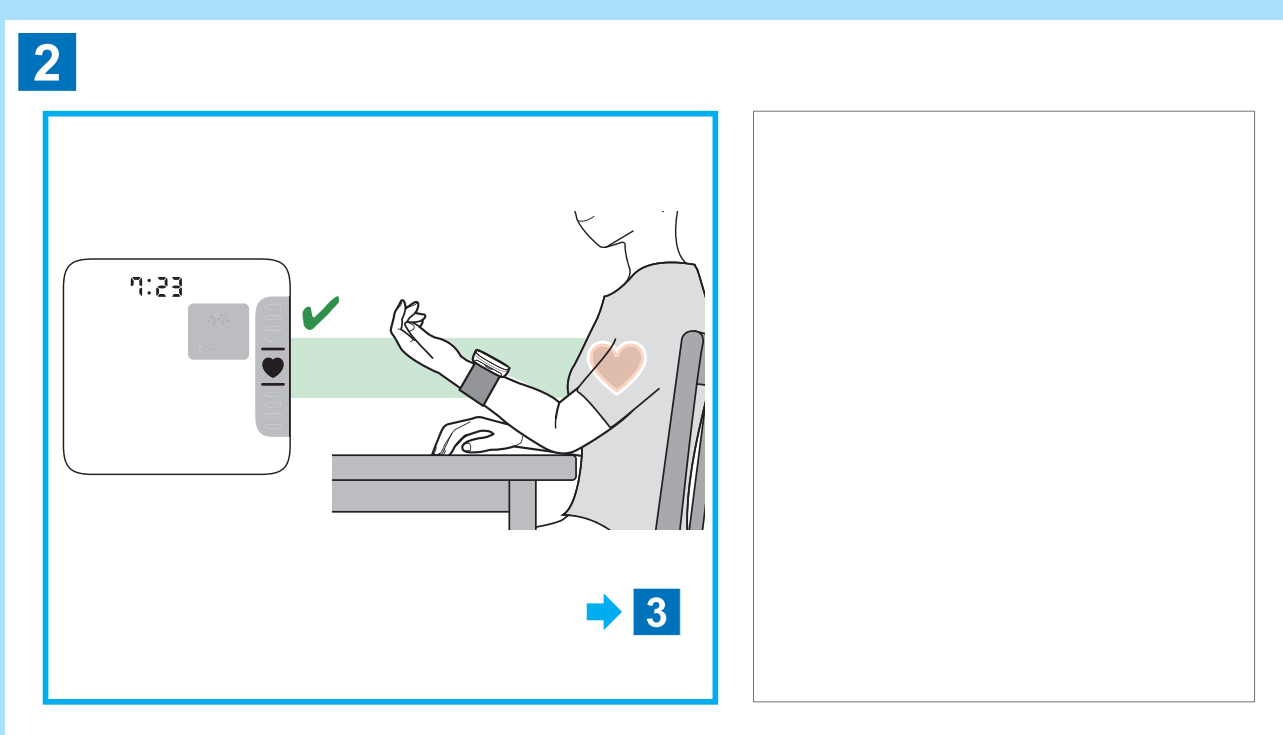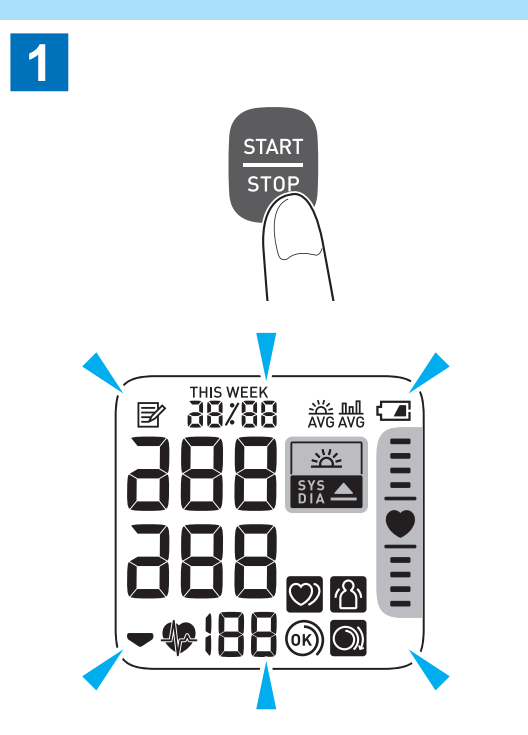




## Prezeranie výsledkov merania uložených v pamäti

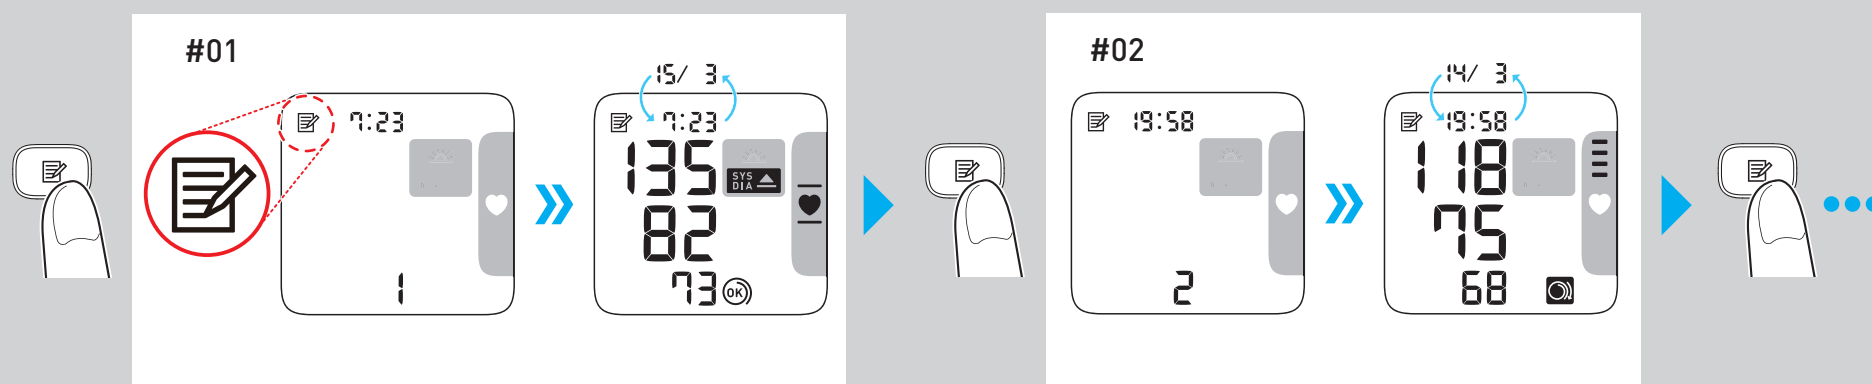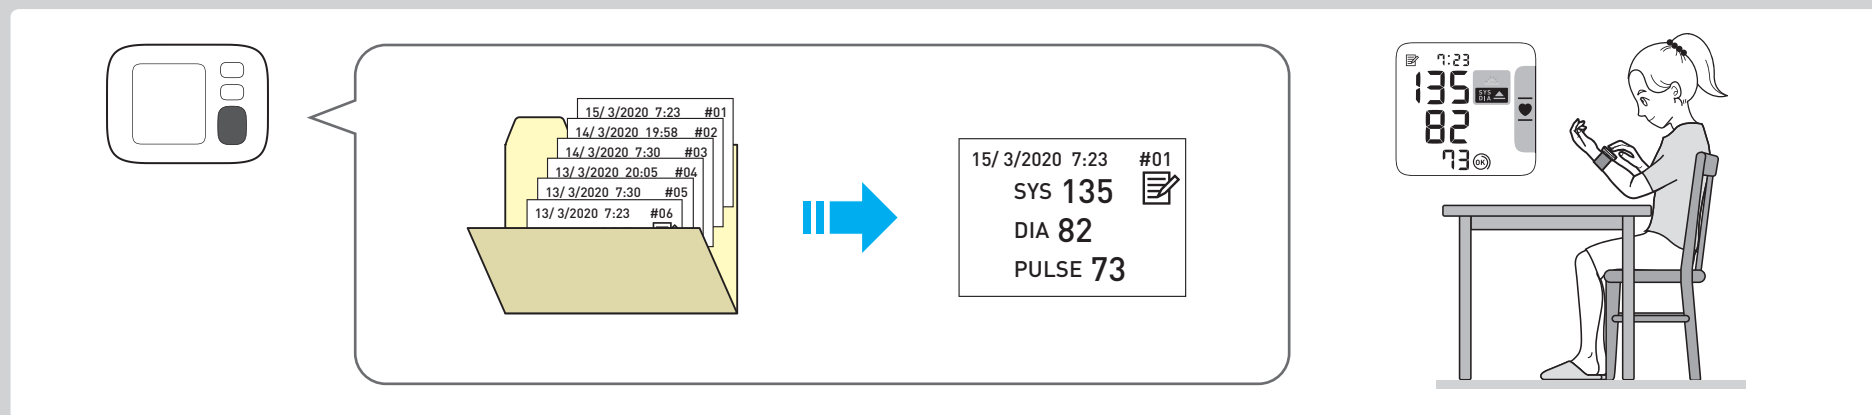

## Vymazanie všetkých výsledkov merania uložených v pamäti

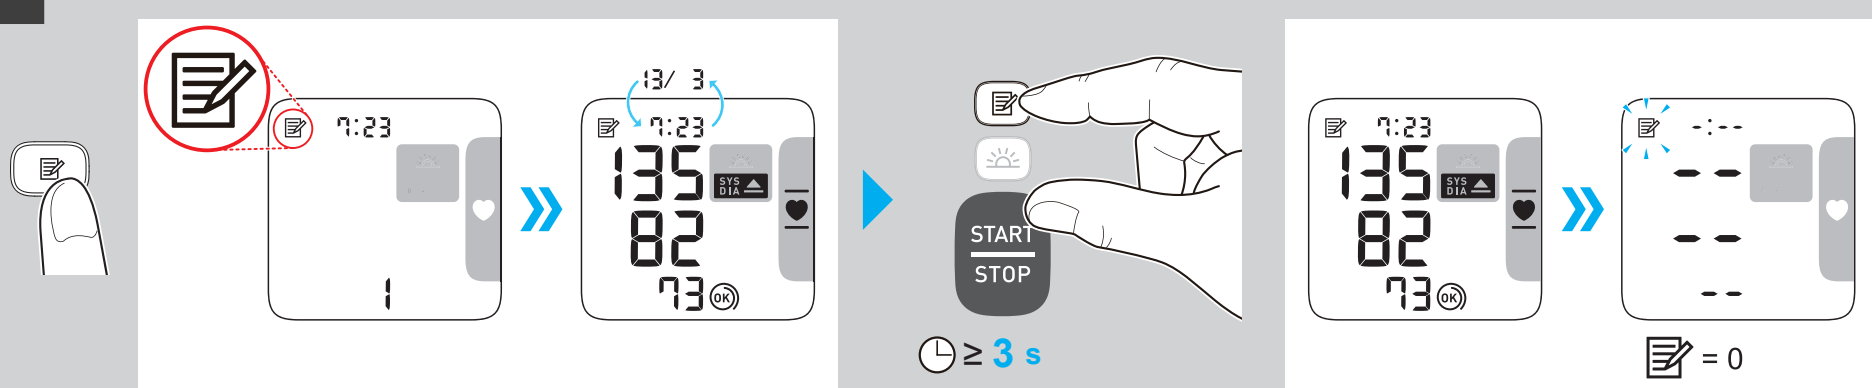

## Opis symbolov

	Pripojená časť – Typ BF: Stupeň ochrany pred zásahom elektrickým prúdom (zvodovým prúdom)		Teplotné obmedzenie
	Určuje správnu polohu merača na zápästí. Merateľný obvod zápästia 13.5-21.5cm		Vlhkostné obmedzenie
IP XX	Stupeň ochrany proti vniknutiu podľa IEC 60529		Obmedzenie atmosférického tlaku
CE	Označenie CE		Je potrebné, aby používateľ nahliadol do tohoto návodu na použitie.
UK CA	Certifikácia UKCA		Je potrebné, aby používateľ z dôvodu vlastnej bezpečnosti presne dodržiaval tento návod na použitie.
SN	Sériové číslo		Batéria/blok
UDI	Unikátny identifikátor pomôcky (UDI)		Jednosmerný prúd
MD	Zdravotnícka pomôcka		Dátum výroby

Výrobca		<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zastúpenie v EÚ		<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANSKO www.omron-healthcare.com
Dovozca pre EÚ		
Výrobná prevádzka		<b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Dcérske spoločnosti	Dovozca pre Spojené kráľovstvo a zodpovedná osoba v UK	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> www.omron-healthcare.com/distributors
		<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> www.omron-healthcare.com/distributors
Dátum vydania		2022-06-27