











2

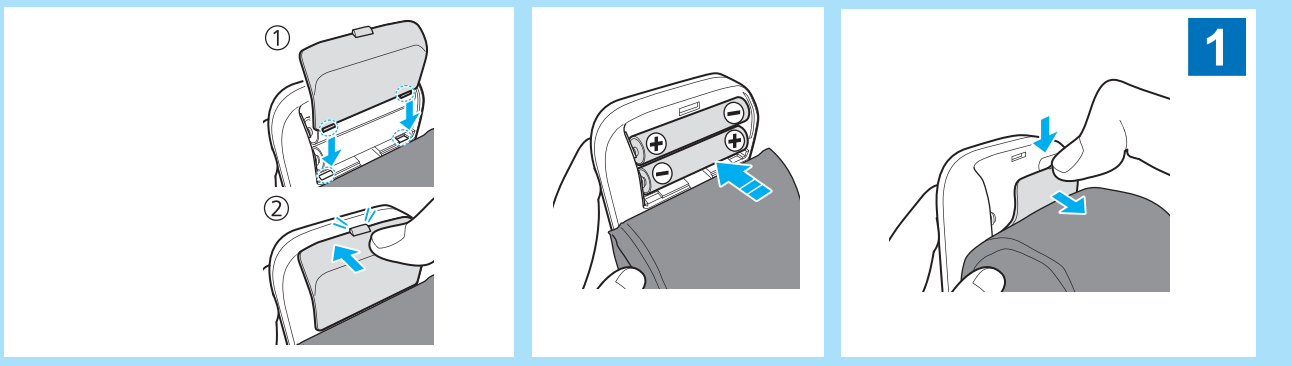



2






4

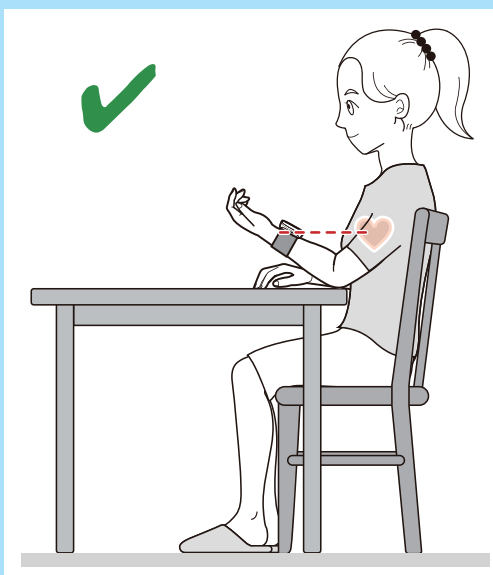

3



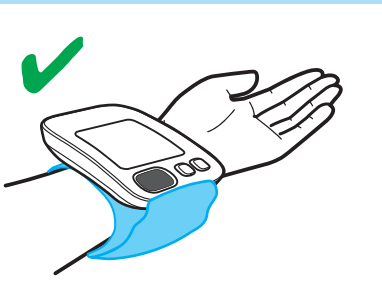
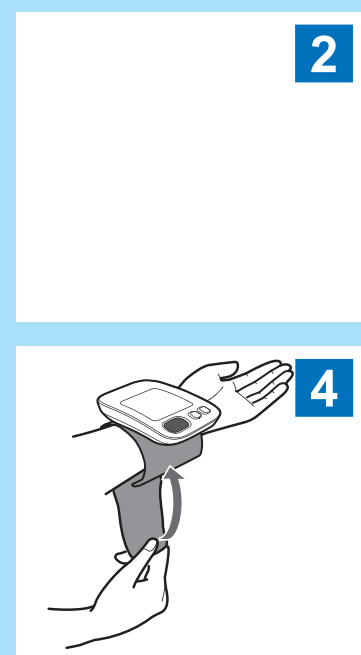


5

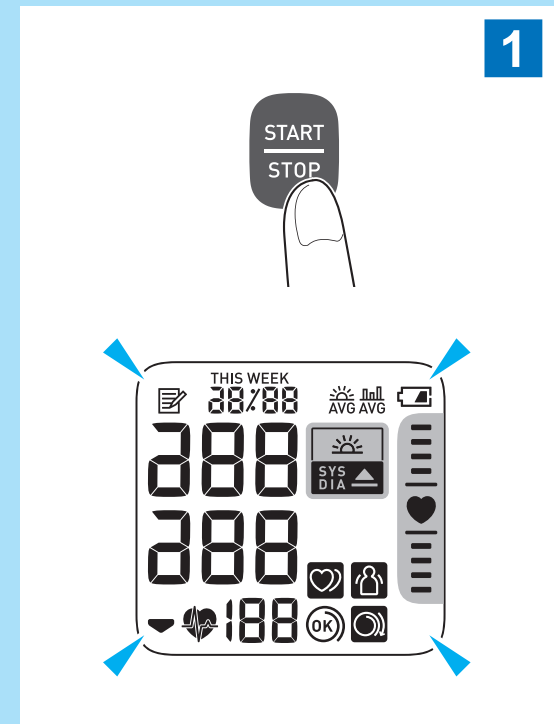
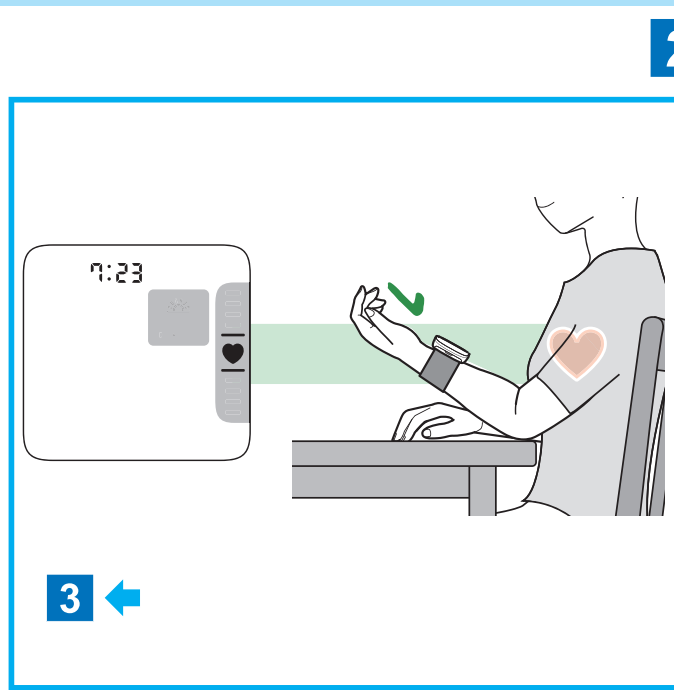



SYS DIA

SYS ≥ 135 mmHg DIA ≥ 85 mmHg

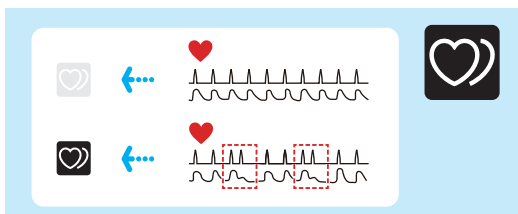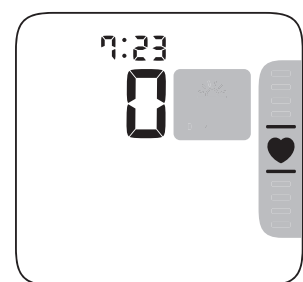

3

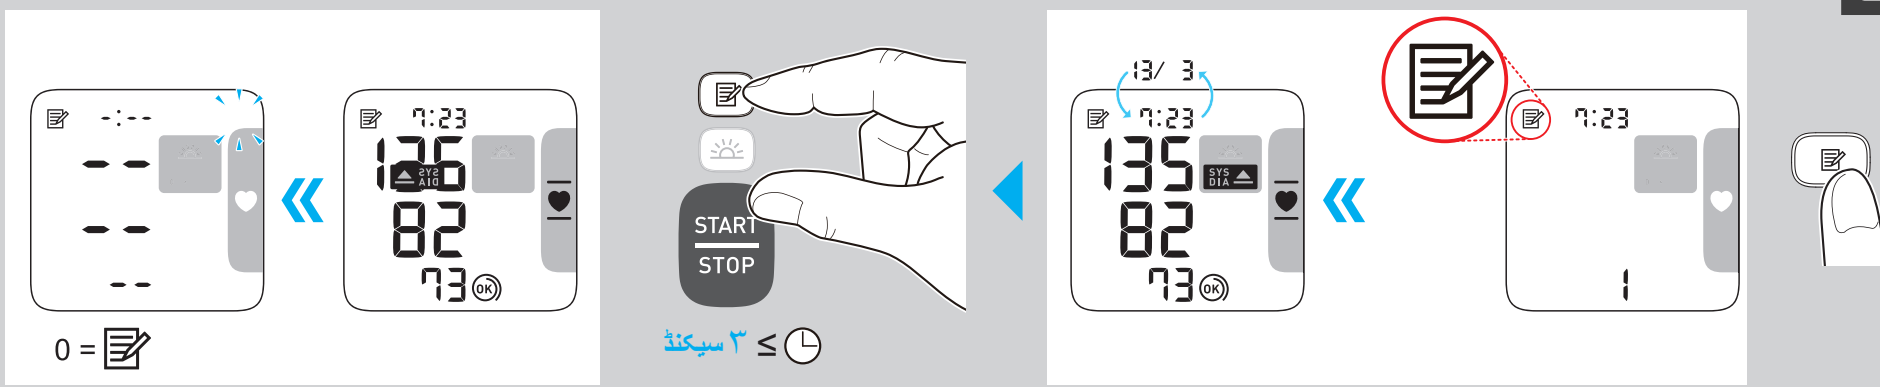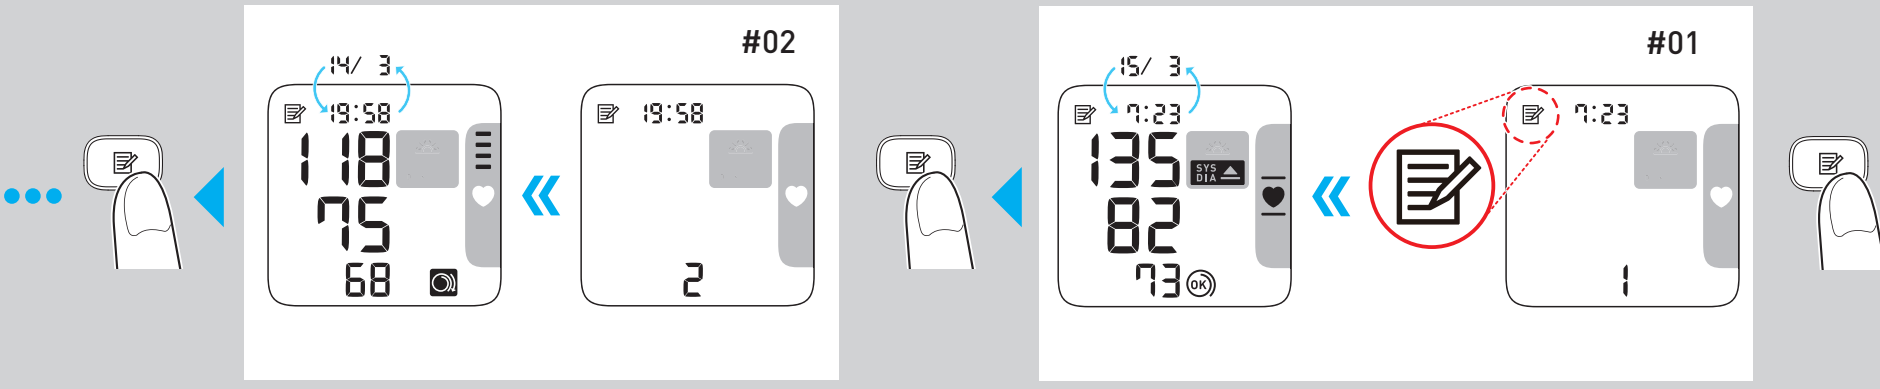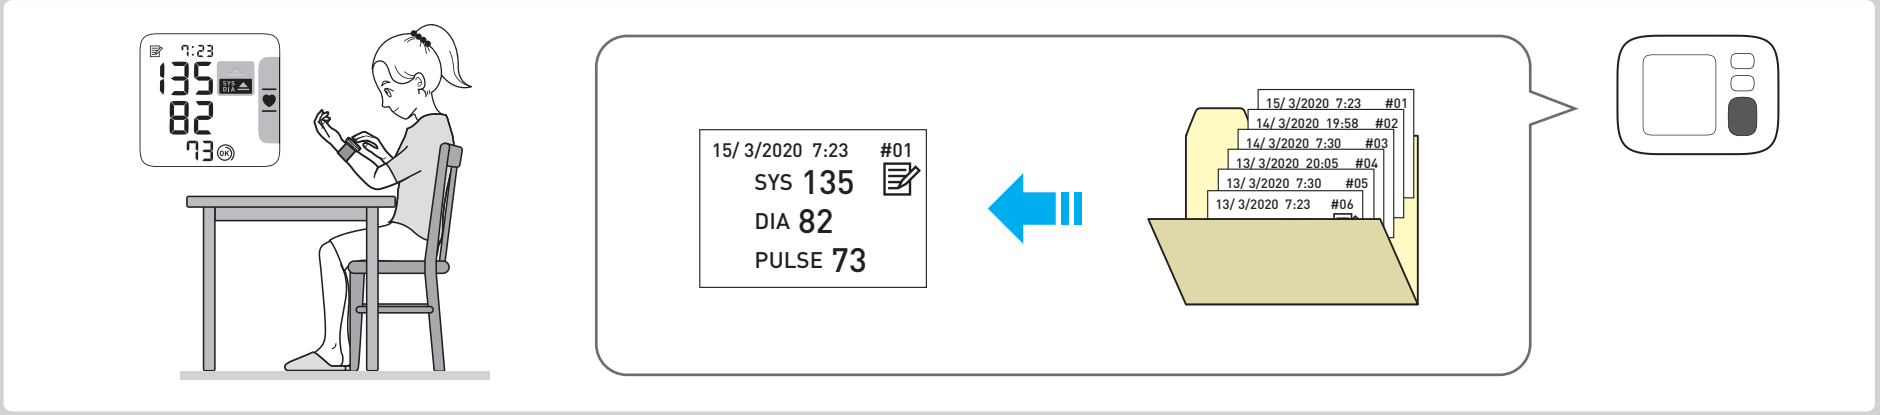

علامات کی وضاحت

درجہ حرارت کی حد		(بجلی کے چھتکے سے تحفظ کا درجہ (الیکٹریک کرینٹ BF): اطلاق شدہ حصہ - قسم	
نمی کی حد		کلاسی پر مانیٹر کی صحیح پوزیشننگ دکھاتا ہے، قابل پیمائش کلاسی کی گر لائی	 13.5-21.5cm
ماحولیاتی دباؤ کی حد		کے ذریعے فراہم کردہ انگریس تحفظ ڈگری IEC 60529	IP XX
صارفین کے لئے اس مینول برائے ہدایات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔		نشان دیے CE	CE
اپنے تحفظ کے لئے صارف کو چاہیے کہ اس مینول برائے ہدایات کی اچھی طرح سے پیروی کریں		UKCA مارکنگ	UK CA
بیٹری / البٹار		سیریل نمبر	SN
ڈائریکٹ کرینٹ		الہ کا منفرد شناخت کار	UDI
تعمیر کی تاریخ		طبی الہ	MD

<p><b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 جاپان</p>	تخلیق کار
<p><b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com</p>	<p>EU - نمائندہ</p> <p><b>EC REP</b></p> <p>EU میں درآمد کنندہ</p>
<p><b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam</p>	تخلیقی سپلائی
<p><b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors</p>	برطانیہ اور برطانیہ میں درآمد کنندہ نمہ دار شخص
<p><b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> www.omron-healthcare.com/distributors</p>	ذیلی کمپنیاں
<p><b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> www.omron-healthcare.com/distributors</p>	
2022-06-27	جاری کرنے کی تاریخ