EL

OMRON

Θερμόμετρο υπέρυθρων μετώπου
Gentle Temp 730 (MC-F300-E)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

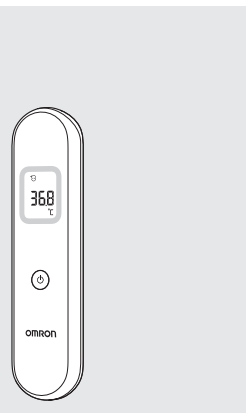

All for Healthcare

IM-MC-F300-E-EL-04-07/2025

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το Θερμόμετρο υπέρυθρων μετώπου OMRON. Φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο οδηγών πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτό το Εγχειρίδιο οδηγών σε μέρος όπου μπορείτε να ανατρέξετε εύκολα σε αυτό στο μέλλον.

Προορισμένη χρήση

Προβλεπόμενος σκοπός
Αυτή η συσκευή είναι ένα ψηφιακό θερμόμετρο που προορίζεται για χρήση στη μέτρηση της θερμοκρασίας από το μέτωπο.

Προοριζόμενοι ασθενείς
Όλες οι ηλικίες

Προοριζόμενοι χρήστες
Όλες οι ηλικίες (μπορεί να περιλαμβάνει τους ίδιους τους ασθενείς) που μπορούν να κατανοήσουν αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

Κλινικό όφελος
Η θερμοκρασία του χρήστη μπορεί να μετρηθεί με ασφάλεια, άνεση και ταχύτητα σε οικιακό περιβάλλον.

Τύπος χρήσης
Αυτή η συσκευή προορίζεται για πολλαπλή χρήση από πολλαπλούς ασθενείς.

Περιορισμός
Η θερμοκρασία του ασθενή πρέπει να είναι 34,0 °C (93,2 °F) έως 43,0 °C (109,4 °F)
σε περιβάλλον κάτω από 5,0 °C (41,0 °F) έως 40,0 °C (104,0 °F)

Ένδειξη
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από υγιή άτομα ή/και ασθενείς με πιθανότητα απόκλισης της θερμοκρασίας σώματος, σε οικιακό περιβάλλον για τη μέτρηση της θερμοκρασίας από το μέτωπο.

Παραλαβή και έλεγχος

Αφαιρέστε αυτή την κύρια μονάδα και τα άλλα εξαρτήματα από τη συσκευασία και ελέγξτε τα για τυχόν ζημιές. Εάν αυτή η κύρια μονάδα ή οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά, ΜΗΝ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ και συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της OMRON.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο οδηγών προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
Ακολουθήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγών πιστά για την ασφάλειά σας.

Αντενδείξεις

ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το μέτωπο έχει ουλές ή τραυματισμούς του δέρματος, όπως εγκαύματα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες

⚠ **Προειδοποίηση**	Καταδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρή κάκωση.

- Η αυτοδιάγνωση με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες του. Η αυτοδιάγνωση μπορεί να οδηγήσει στην επιδείνωση των υφιστάμενων παθήσεων.
- Ένας υψηλός ή παρατεταμένος πυρετός απαιτεί ιατρική φροντίδα, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- ΜΗΝ πετάτε μπαταρίες σε φωτιά. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή ταυτόχρονα με άλλο ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Μπορεί να προκύψει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή/και να προκληθεί ανακριβή μέτρηση.
- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά, νήπια και βρέφη.

⚠ **Προφύλαξη**	Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό του χρήστη ή του ασθενούς ή να προκαλέσει βλάβη της συσκευής ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.

- Αν ένα παιδί καταπιεί την μπαταρία, επικοινωνήστε αμέσως με ιατρό.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για 3 μήνες ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρού, παραγωγή θερμότητας ή έκρηξη, προκαλώντας βλάβη στη συσκευή.
- ΜΗ μίγνετε και μην ενθέτετε αυτή τη συσκευή σε ισχυρούς κραδασμούς ή δονήσεις.
- Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό αυτής της συσκευής, ώστε να μην εισέλθει υγρό στη συσκευή. Όταν η συσκευή βραχεί με σπυρί, σκουπίστε την έλαφρά με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί ανακριβής μέτρηση ή/και να προκύψει εσφαλμένη λειτουργία της θερμόμετρου.
- Αν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του μέρους όπου φυλάσσεται η συσκευή και του μέρους όπου θα λάβετε τη μέτρηση, αφήστε τη συσκευή στο χώρο όπου πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για πάνω από 30 λεπτά ώστε να έρθει πρώτα σε θερμοκρασία δωματίου και μετά λάβετε τη μέτρηση.
- Αν το μέτωπο είναι κρύο, περιμένετε έως ότου ζεσταθεί το μέτωπο πριν λάβετε μια μέτρηση θερμοκρασίας. Το αποτέλεσμα της μέτρησης μπορεί να είναι χαμηλό όταν χρησιμοποιείτε παγοσακούλα ή παγοκύστη ή όταν έχετε μόλις μπει σε εσωτερικό χώρο από έξω το χειμώνα.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι βρεγμένο το μέτωπο, όπως μετά από κολύμπι, μπάνιο ή αν έχετε ιδρώσει μετά από σωματική άσκηση, καθώς η θερμοκρασία του δέρματος μπορεί να έχει μειωθεί. Σκουπίστε τυχόν υγρασία και αφήστε να περάσουν 30 λεπτά ώστε το σώμα να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν από τη μέτρηση.
- ΜΗΝ ακουμπάτε τον αισθητήρα με το δάκτυλο και μην ανασαίνετε επάνω του.
- ΜΗΝ προσπαθήσετε να λάβετε μετρήσεις όταν η συσκευή είναι βρεγμένη καθώς οι μετρήσεις μπορεί να είναι ανακριβείς.
- Ελέγξτε το εικονίδιο στην οθόνη πριν και μετά από τη μέτρηση για να διασφαλίσετε ότι η μέτρηση λαμβάνεται με τον κατάλληλο τρόπο.
- Όταν ενημερώνετε τον ιατρό σας για τη θερμοκρασία σας, φροντίστε να αναφέρετε ότι η μέτρηση λήφθηκε από το μέτωπο.
- Απορρίψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. Η παράνομη απόρριψη μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη μέτρηση οποιουδήποτε αντικειμένου με θερμοκρασία υψηλότερη από 100,0 °C (212,0 °F).
- Κατά τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κάποιο κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρική συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε απόσταση μικρότερη από 30 cm από αυτή τη συσκευή. Μπορεί να προκύψει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή/και να προκληθεί ανακριβή μέτρηση.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο ανθρώπινο μέτωπο ή/και τη μέτρηση επιφάνειας.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τις μπαταρίες με λανθασμένα στοιχισμένες τις πολικότητες.
- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ με αυτή τη συσκευή. ΜΗ χρησιμοποιείτε άλλο τύπο μπαταριών. ΜΗ χρησιμοποιείτε κανούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί. ΜΗ χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες μπαταριών μαζί.
- Αν εκέλθει υγρό μπαταρίας στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Συμβουλευθείτε άμεσα έναν ιατρό.
- Αν έλθει σε επαφή με το δέρμα σας υγρό μπαταρίας, πλύνετε το δέρμα σας αμέσως με άφθονο καθαρό, χλιαρό νερό. Αν τυχόν ερεθισμός, τραυματισμός ή πόνος επιμένει, συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε μπαταρίες μετά την ημερομηνία λήξης τους.

Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες

Πώς λειτουργεί το θερμόμετρο μετώπου Gentle Temp 730

Η συσκευή αυτή μετράει τη θερμοκρασία στην επιφάνεια του μετώπου ανιχνεύοντας την εκπομπή υπέρυθρων του δέρματος στο σημείο μέτρησης και, στη συνέχεια, υπολογίζει την ισοδύναμη τιμή θερμασίας αυτού χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό αλγόριθμο με βάση δεδομένα ερευνών της πραγματικής θερμοκρασίας σώματος.

Σχετικά με τη θερμοκρασία σώματος

Η θερμοκρασία σώματος αναφέρεται στη σταθερή θερμοκρασία του εσωτερικού του σώματος (γνωστή επίσης ως θερμοκρασία πυρήνα του σώματος). Ενώ οι μετρήσεις της θερμοκρασίας στη μασχάλη ή το αυτί παρέχουν τιμές θερμοκρασίας επιφάνειας, η σταθερή διατήρηση του θερμομέτρου στο σημείο μέτρησης για περίπου 10 λεπτά παρέχει μια μέτρηση θερμοκρασίας που αντιπροσωπεύει καλύτερα αυτήν της θερμοκρασίας πυρήνα του σώματος. Καθώς η μέτρηση της θερμοκρασίας του μετώπου δεν περιλαμβάνει καμία υποστήριξη του θερμόμετρου από το σώμα, το αποτέλεσμα της μέτρησης της θερμοκρασίας είναι συνήθως χαμηλότερο από αυτό της μασχάλης ή του αυτιού. Ωστόσο, καθώς το μέτωπο έχει ευρύτερα αγγεία που είναι λιγότερο πιθανό να υποστούν αγγειοσυστολή (μια φυσιολογική λειτουργία της προσαρμογής της θερμοκρασίας του σώματος), θεωρείται μια καλύτερη περιοχή μέτρησης για τον καθορισμό της θερμοκρασίας πυρήνα του σώματος, ακόμα και σε περιβάλλον με χαμηλότερη θερμοκρασία. Αντίθετα, η θερμοκρασία που μετριέται στο χέρι ή στο πόδι, για παράδειγμα, δεν αποτελεί κατάλληλη ένδειξη της θερμοκρασίας πυρήνα του σώματος, καθώς αυτές οι περιοχές του σώματος είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν αγγειοσυστολή. (Επισημαίνεται ότι η θερμοκρασία που μετριέται στο μέτωπο μπορεί ακόμα να επηρεαστεί από άλλες συνθήκες, όπως ο ιδρώτας ή ο αέρας από ένα κλιματιστικό, κ.λπ. Συνεπώς, συνιστάται να πραγματοποιείται η μέτρηση σε όσο το δυνατόν γίνεται πιο σταθερό περιβάλλον.)
Κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας ενός βρέφους, λάβετε υπόψη ότι η θερμοκρασία σώματος των βρεφών είναι γενικά υψηλότερη από τη θερμοκρασία σώματος των ενηλίκων και επηρεάζεται εύκολα από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία σώματος έχει την τάση να αυξάνεται μετά το θηλασμό ή το κλάμα.
Συνεπώς, συνιστάται η λήψη των μετρήσεων να γίνεται όταν το βρέφος βρίσκεται σε ήρεμη και κανονική κατάσταση.

Γνωρίζοντας τη φυσιολογική θερμοκρασία ενός ατόμου

Προκειμένου να κρίνετε σωστά όταν υποπτεύεστε ότι κάποιος έχει πυρετό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη φυσιολογική θερμοκρασία του ατόμου. Η φυσιολογική θερμοκρασία διαφέρει ανά άτομο και επίσης αλλάζει ανάλογα με την ώρα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, η μετρηθείσα θερμοκρασία σώματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το θερμόμετρο ή το μέρος του σώματος όπου λαμβάνεται η μέτρηση. Για να μάθετε, λοιπόν, τη φυσιολογική θερμοκρασία ενός ατόμου, συνιστάται η λήψη τακτικών μετρήσεων στις ακόλουθες συνθήκες:
- Μέτρηση με το ίδιο θερμόμετρο.
- Μέτρηση στην ίδια περιοχή.
- Μέτρηση την ίδια ώρα της ημέρας.

1 Επισκόπηση

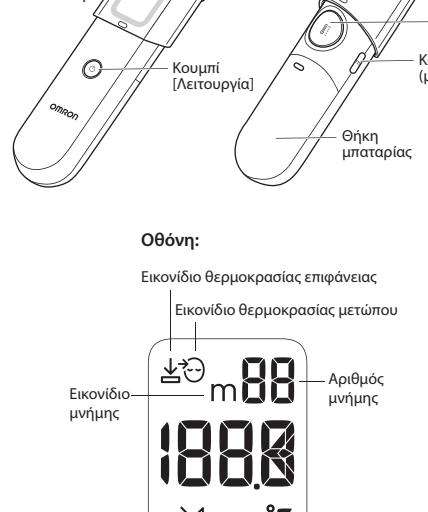

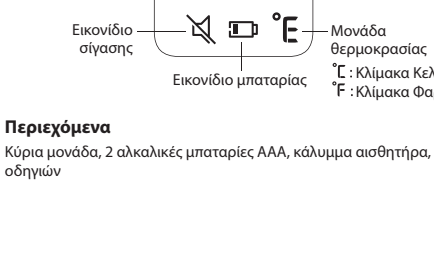

Περιεχόμενα
Κύρια μονάδα, 2 αλκαλικές μπαταρίες AAA, κάλυμμα αισθητήρα, εγχειρίδιο οδηγών

2 Προετοιμασία

2.1 Εγκατάσταση/Αντικατάσταση των μπαταριών

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.
- Πιέστε προς τα κάτω το βέλος (1) στο κάλυμμα των μπαταριών και σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους (2).



2 Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες AAA όπως υποδεικνύεται στη θήκη μπαταριών.



3 Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.
- Η οθόνη εμφανίζεται όπως στην παρακάτω εικόνα.

- Πατήστε το κουμπί [Λειτουργία] για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Όταν η ένδειξη « » (εικονίδιο μπαταρίας) αναβοσβήνει στην οθόνη, συνιστάται η αντικατάσταση των μπαταριών.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες. Κατόπιν, αντικαταστήστε τις με 2 νέες μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Οι παρεχόμενες μπαταρίες ενδέχεται να έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με νέες μπαταρίες.
- Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

2.2 Εναλλαγή μεταξύ °C και °F

Η μονάδα μπορεί να αλλάξει μόνο κατά την εγκατάσταση των μπαταριών. Όταν η μονάδα εναλλάσσεται μεταξύ «°C» και «°F», όλες οι μετρήσεις που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη διαγράφονται.
Η μονάδα είναι ρυθμισμένη σε °C από προεπιλογή.

1 Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη «°C».
- Εάν δεν εμφανίζεται τίποτα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και **περιμένετε περισσότερο από 1 λεπτό**, κατόπιν τοποθετήστε τες ξανά.



2 Πατήστε το κουμπί [m].
- Η μονάδα αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [m].



3 Πατήστε το κουμπί [Μέτρηση].
- Η μονάδα ρυθμίζεται με 2 σύντομα ηχητικά σήματα και κατόπιν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
Για να ξεκινήσετε άμεσα μια μέτρηση θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο βήμα 3 στην ενότητα 3.1.

Σημείωση:
- Εάν πατηθεί το κουμπί [Λειτουργία] αντί για το κουμπί [Μέτρηση], η μονάδα ρυθμίζεται με ένα σύντομο ηχητικό σήμα και, στη συνέχεια, η συσκευή απενεργοποιείται.



3 Χρήση του θερμόμετρου

3.1 Λήψη θερμοκρασίας σώματος (Λειτουργία μέτρησης μετώπου)

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει την ισοδύναμη τιμή θερμοκρασίας αυτού της θερμοκρασίας μετώπου που έχει μετρηθεί.

1 Τραβήξτε απαλά το κάλυμμα του αισθητήρα για να το αφαιρέσετε.
- Η μέτρηση με το κάλυμμα του αισθητήρα δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια.



2 Πατήστε το κουμπί [Λειτουργία].
- Όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.



- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη «°C» (ή «°F»), η συσκευή είναι έτοιμη για μέτρηση.



Σημείωση:
- Εάν αποθηκευτεί μια μέτρηση, εμφανίζεται η προηγούμενη μέτρηση. Στη συνέχεια, η συσκευή είναι έτοιμη μέτρηση.

3 Στρέψτε τον αισθητήρα προς το μέτωπο.
- Όταν ο αισθητήρας φτάσει στην καλύτερη απόσταση για μέτρηση (περίπου 3 cm από το μέτωπο), ο βομβητής εκπέμπει δύο σύντομα ηχητικά σήματα.

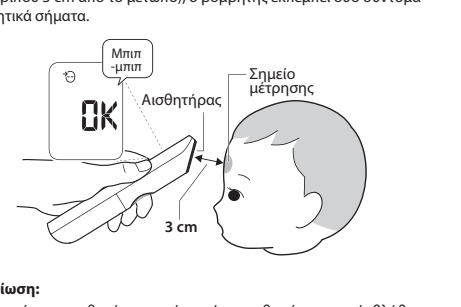

Σημείωση:
- Φροντίστε ο αισθητήρας να είναι πάντα καθαρός και χωρίς βλάβες και το μέτωπο να είναι καθαρό, χωρίς ιδρώτα, μακιγιάζ, σωλές, κ.λπ.

4 Τοποθετήστε το κουμπί [Μέτρηση].
- Η μέτρηση ολοκληρώνεται σε 1 δευτερόλεπτο με ένα μακρό ηχητικό σήμα.



5 Ελέγξτε το αποτέλεσμα της μέτρησης.
- Μετά από 1 δευτερόλεπτο, αναβοσβήνει η ένδειξη «°C» (ή «°F»). Στη συνέχεια, η συσκευή είναι έτοιμη για την επόμενη μέτρηση.
Για να ξεκινήσετε αμέσως ξανά μια μέτρηση θερμοκρασίας, επαναλάβετε τα βήματα από το βήμα 3.

6 Πατήστε το κουμπί [Λειτουργία].
- Η συσκευή απενεργοποιείται με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του αισθητήρα μετά τη μέτρηση για να προστατεύσετε τον αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Μην κάνετε μπάνιο ή άσκηση εντός 30 λεπτών πριν από τη μέτρηση.
- Παρομοιώστε σε σταθερό περιβάλλον για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από τη μέτρηση.
- Συνιστάται η λήψη 3 μετρήσεων. Εάν οι 3 μετρήσεις είναι διαφορετικές, επιλέξτε την υψηλότερη ως τη σωστή θερμοκρασία.

3.2 Έλεγχος της μνήμης

Αυτή η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα τις τελευταίες 30 μετρήσεις. Οι αποθηκευμένες μετρήσεις μπορούν να διαβαστούν στην οθόνη της συσκευής.

1 Τοποθετήστε το κουμπί [m].
- Η πιο πρόσφατη μέτρηση εμφανίζεται με ένα μακρό ηχητικό σήμα.
Το εικονίδιο « m1 » (εικονίδιο μνήμης) εμφανίζεται στην οθόνη.



- Η προηγούμενη μέτρηση και ο αντίστοιχος αριθμός μνήμης εμφανίζονται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [m]. Όταν εμφανίζεται η παλαιότερη μέτρηση, πατήστε το κουμπί [m] για να εμφανιστεί ξανά η πιο πρόσφατη μέτρηση.

Σημείωση:
- Εάν πατηθεί το κουμπί [Μέτρηση] κατά την περιήγηση στη μνήμη, η συσκευή θα είναι έτοιμη για μέτρηση.

2 Πατήστε το κουμπί [Λειτουργία].
- Η συσκευή απενεργοποιείται με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα.

3.3 Λήψη θερμοκρασίας επιφάνειας (Λειτουργία μέτρησης επιφάνειας)

Στη λειτουργία μέτρησης επιφάνειας, η συσκευή δείχνει την πραγματική και μη προσαρμοσμένη θερμοκρασία επιφάνειας ενός αντικειμένου.
Η λειτουργία μέτρησης μετώπου έχει οριστεί ως προεπιλογή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μεταβείτε σε λειτουργία μέτρησης επιφάνειας.

1 Τραβήξτε απαλά το κάλυμμα του αισθητήρα για να το αφαιρέσετε.
- Η μέτρηση με το κάλυμμα του αισθητήρα δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια.



2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [Λειτουργία] για 3 δευτερόλεπτα.
- Όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.



- Όταν το εικονίδιο « » (εικονίδιο θερμοκρασίας επιφάνειας) παραμένει αναμμένο και αναβοσβήνει η ένδειξη «°C» (ή «°F»), η συσκευή είναι έτοιμη για μέτρηση.



Σημείωση:
- Εάν το κουμπί [Λειτουργία] απελευθερωθεί μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, το εικονίδιο « » (εικονίδιο θερμοκρασίας μετώπου) εμφανίζεται και η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία μέτρησης μετώπου. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

3 Μετακινήστε τη συσκευή κοντά στο αντικείμενο που πρόκειται να μετρηθεί και πατήστε το κουμπί [Μέτρηση]. Η συνιστώμενη απόσταση μεταξύ της συσκευής και του αντικειμένου είναι 3 cm.
- Η μέτρηση ολοκληρώνεται σε 1 δευτερόλεπτο με ένα μακρό ηχητικό σήμα.



4 Ελέγξτε το αποτέλεσμα της μέτρησης.
- Μετά από 1 δευτερόλεπτο, η ένδειξη «°C» (ή «°F») αναβοσβήνει και τότε η συσκευή είναι έτοιμη για την επόμενη μέτρηση.
Για να ξεκινήσετε αμέσως ξανά μια μέτρηση θερμοκρασίας, επαναλάβετε τα βήματα από το βήμα 3.

5 Πατήστε το κουμπί [Λειτουργία].
- Η συσκευή απενεργοποιείται με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του αισθητήρα μετά τη μέτρηση για να προστατεύσετε τον αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Όταν απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η συσκευή επιστρέφει στη λειτουργία μέτρησης μετώπου.
- Οι ενδείξεις μέτρησης επιφάνειας δεν αποθηκεύονται.
- Ενώ η λειτουργία μέτρησης επιφάνειας είναι ενεργοποιημένη, ο βομβητής δεν έχει ακόμα και αν η απόσταση από το αντικείμενο είναι 3 cm.
- Στη λειτουργία μέτρησης επιφάνειας, η συσκευή δείχνει τη μέτρηση θερμοκρασίας επιφάνειας ενός αντικειμένου. Η θερμοκρασία επιφάνειας του αντικειμένου και η εσωτερική του θερμοκρασία μπορεί να διαφέρουν.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές όταν μετράτε αντικείμενα με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.
- Για την αποτροπή ζημιάς στη συσκευή, ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη μέτρηση οποιουδήποτε αντικειμένου με θερμοκρασία υψηλότερη από 100,0 °C (212,0 °F).
- Μπορεί να προκύψουν ανακριβείς μετρήσεις ανάλογα με τα αντικείμενα.
- Η λειτουργία μέτρησης επιφάνειας δεν προορίζεται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος ή για ιατρική χρήση.

4 Ρυθμίσεις

4.1 Ρύθμιση του βομβητή

Ο βομβητής είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή. Για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [Μέτρηση], πατήστε το κουμπί [Λειτουργία].
- Αφού εμφανιστούν όλες οι ενδείξεις στην οθόνη, εμφανίζεται το εικονίδιο « » (εικονίδιο σίγασης) στην οθόνη.
- Για να ενεργοποιήσετε τον βομβητή, επαναλάβετε αυτό το βήμα. Η ένδειξη «°C» (ή «°F») εμφανίζεται χωρίς το εικονίδιο « » (εικονίδιο σίγασης).



4.2 Διαγραφή όλων των μετρήσεων

Για να διαγραφούν όλες τις μετρήσεις που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [m], πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [Λειτουργία] για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
- Η ένδειξη «CLR» αναβοσβήνει με 2 σύντομα ηχητικά σήματα.
- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία διαγραφής, πατήστε το κουμπί [Λειτουργία].



2 Πατήστε το κουμπί [m] για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
- Η ένδειξη «CLR» σταματά να αναβοσβήνει με ένα μακρό ηχητικό σήμα, έπειτα όλες οι μετρήσεις διαγράφονται.



3 Τοποθετήστε το κουμπί [Λειτουργία].
- Η συσκευή απενεργοποιείται με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα.

5 Συντήρηση

- **Αποθηκεύετε τη συσκευή με το κάλυμμα αισθητήρα.**
- **Ελέγξτε ότι η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σωστά εάν έχει πέσει. Εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της OMRON για να ελέγξει τη συσκευή.**
- **Όταν η συσκευή λερωθεί, σκουπίστε την ελαφρά με ένα μαλακό στεγνό πανί. Για επίμονους λεκέδες, σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί που έχει υγρανθεί ελαφρά με νερό ή διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στη συνέχεια έχει στραγγιχτεί καλά.**
- **Σκουπίστε τον αισθητήρα προσεκτικά για να μην προκληθεί βλάβη.**
  - Χρησιμοποιήστε ένα μπαντάζ με συνάντηση 70 % ή μεγαλύτερη βαμβάκι νοτισμένο με οινόπνευμα 70 % για να καθαρίσετε τον αισθητήρα.
  - Αφήστε τον αισθητήρα να στεγνώσει πλήρως για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν από τη χρήση.
- **Για να αποφευχθεί ζημιά στη συσκευή, μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπως:**
  - Υγροί χώροι.
  - Χώροι με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία ή χώροι εκτεθειμένοι σε άμεσο ηλιακό φως.
  - Χώροι που βρίσκονται κοντά σε συσκευές θέρμανσης, σκόνη ή περιβάλλοντα με υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων στον αέρα.
  - Σε σημεία η συσκευή θα πέσει κλίση, είναι πιθανό να πέσει ή θα υποβληθεί σε κραδασμό ή δόνηση.
  - Χώροι ή θέσεις φύλαξης φαρμάκων όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα προκύψουν κατά τη μέτρηση, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει άλλη ηλεκτρική συσκευή σε απόσταση μικρότερη από 30 cm από τη συσκευή. Αν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Ένδειξη/ Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/Λύση
αναβοσβήνει	**Η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή.** ▶ Συνιστάται η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με καινούριες. (Ανατρέξτε στην ενότητα 2.1)
εμφανίζεται	**Οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί.** ▶ Αντικαταστήστε άμεσα και τις δύο μπαταρίες με καινούριες. (Ανατρέξτε στην ενότητα 2.1)
Η θερμοκρασία που υποδεικνύεται είναι αρκετά υψηλή.	**Η συσκευή έχει φυλαχθεί σε κρύο μέρος.** ▶ Όταν η συσκευή έχει φυλαχθεί σε κρύο μέρος οι μετρήσεις μπορεί να είναι πολύ υψηλές εάν μετρήσετε τη θερμοκρασία λίγο μετά που φέρετε τη συσκευή σε δωμάτιο με φυσιολογική θερμοκρασία. Μετρήστε τη θερμοκρασία αφού αφήσετε τη συσκευή για 30 λεπτά στο δωμάτιο όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Συνιστάται να φυλάσσετε τη συσκευή στο δωμάτιο όπου πρόκειται να μετρήσετε τη θερμοκρασία.
	Ο αισθητήρας έχει εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως. ▶ Αποθηκεύστε τη συσκευή σε μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
	Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά που έκλαιγε το άτομο. Το κλάμα μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του προσώπου. ▶ Μετρήστε ξανά τη θερμοκρασία μετά από λίγο.
	Η μέτρηση έγινε σε εξωτερικό χώρο. ▶ Μετρήστε τη

Περιορισμένη εγγύηση

Η OMRON εγγυάται αυτό το προϊόν για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Κάθε βλάβη που προκαλείται από εσφαλμένη χρήση, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Επίσης, οι μπαταρίες και η συσκευασία εξαιρούνται από την εγγύηση.
Όλες οι λοιπές διεκδικήσεις αποζημίωσης εξαιρούνται.
Κάθε διεκδίκηση βάσει εγγύησης πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Περιγραφή συμβόλων

	Σημείο εφαρμογής - Τύπος BF Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία (ρεύμα διαρροής)
	Αριθμός σειράς
IP XX	Βαθμός προστασίας από εισχώρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529
	Σήμανση CE
	Περιορισμός υγρασίας
	Περιορισμός θερμοκρασίας
	Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης
MD	Ιατρική Συσκευή
	Ημερομηνία κατασκευής
UDI	Αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	Ο χρήστης πρέπει να ακολουθεί το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για τη δική σας ασφάλεια. (Φόντο: μπλε)
	Οδηγίες ανακύκλωσης για τα στοιχεία συσκευασίας
UK CA	Σήμανση UKCA
LOT	Αριθμός παρτίδας
	Σήμα ανακύκλωσης X: Αριθμός υλικού Y: Συντομογραφία υλικού Ανατρέξτε στο 97/129/ΕΚ για περισσότερες πληροφορίες.

https://www.omron-healthcare.com/

Κατασκευαστής	**OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.** 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 ΙΑΠΩΝΙΑ
EC REP **Αντιπρόσωπος στην ΕΕ**	**OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.** Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, ΟΛΛΑΝΔΙΑ www.omron-healthcare.com
Εισαγωγέας στην ΕΕ	
Εργοστάσιο παραγωγής	**AViTA (WUJIANG) CO.,LTD** No.858, Jiao Tong Road, Wujiang Economic Development Zone, Jiangsu, 215200 Κίνα
Θυγατρικές	Importer in the United Kingdom and UK responsible person
	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors

Κατασκευάζεται στην Κίνα

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-07-10